Pile Dynamics, Inc.

Transducer 799W

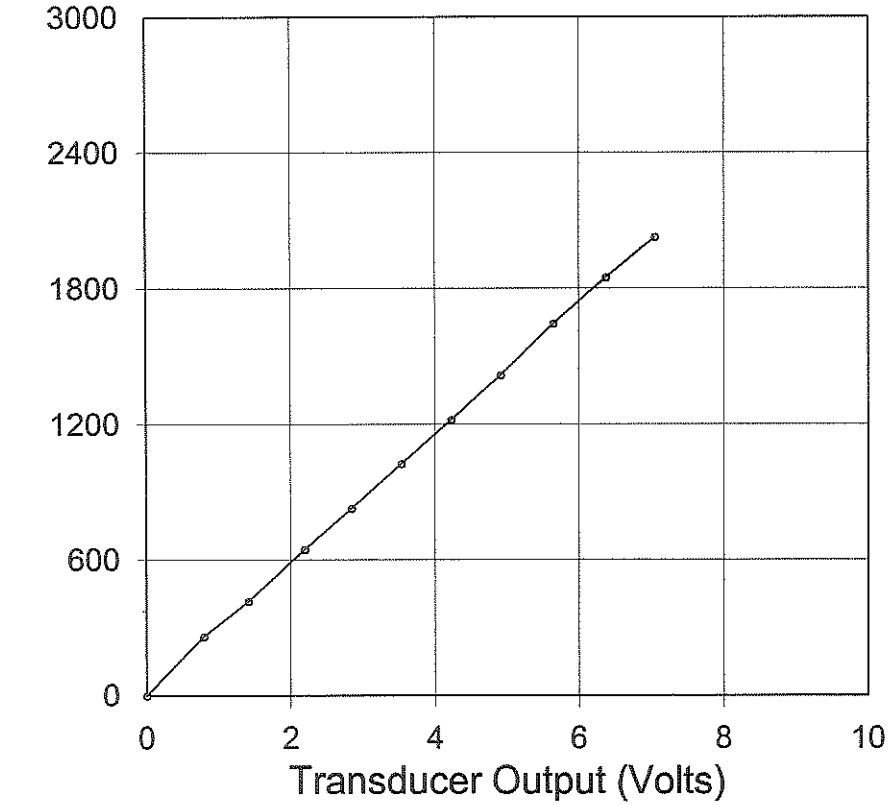

PDA Cal Factor (5.0 V) 143.5με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
261	0.79
417	1.41
644	2.19
826	2.84
1023	3.53
1218	4.22
1418	4.91
1645	5.64
1849	6.38
2028	7.05

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 498.1με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 16-Nov-2009

Strain Transducer Calibrator System 2009 Version 1.3