Pile Dynamics, Inc.

Transducer 802W

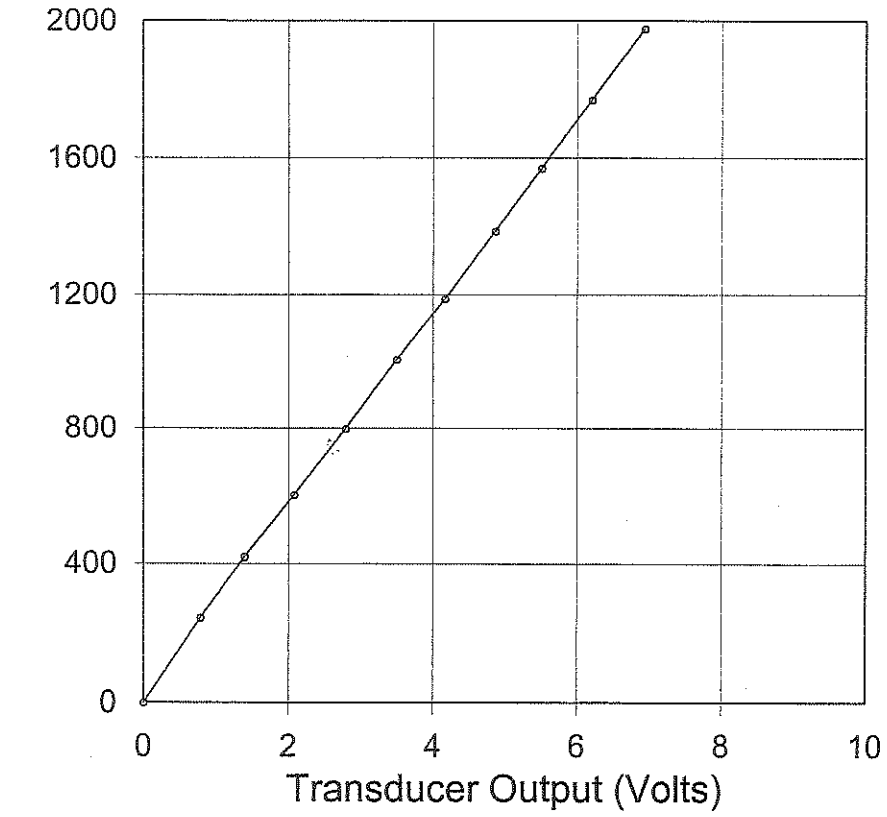

PDA Cal Factor (5.0 V) 141.5με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
241	0.78
420	1.39
601	2.07
798	2.78
1006	3.49
1187	4.16
1387	4.86
1570	5.50
1769	6.20
1978	6.93

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 491.4με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 02-Jul-2007

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2