Pile Dynamics, Inc.

Transducer 803W

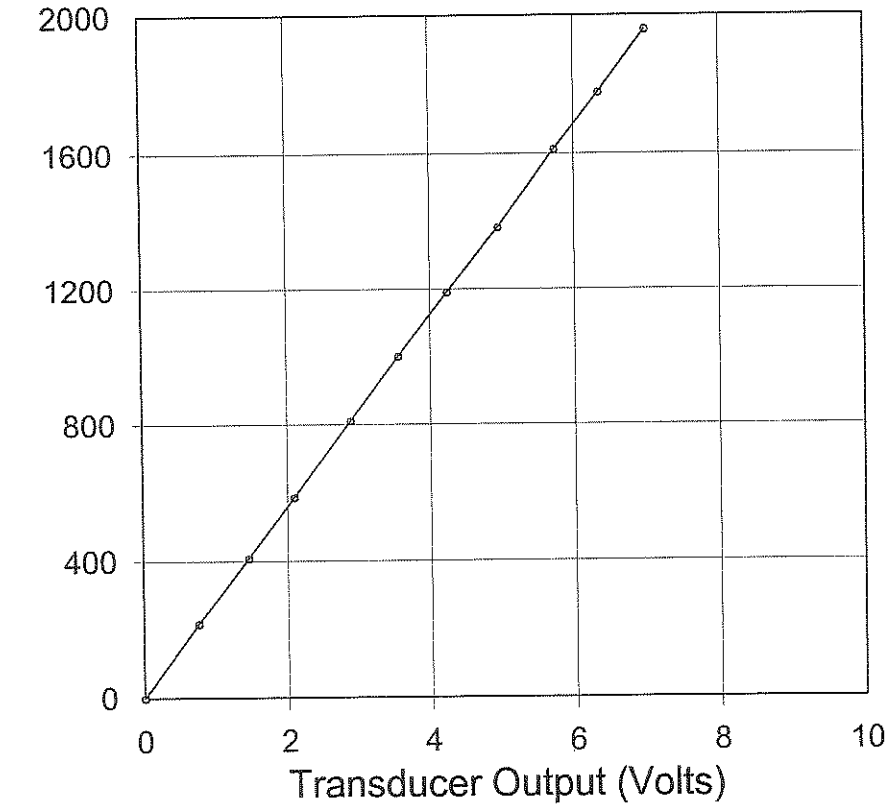

PDA Cal Factor (5.0 V) 140.4με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
217	0.75
407	1.45
586	2.09
810	2.88
1000	3.55
1191	4.23
1385	4.94
1614	5.72
1779	6.34
1960	6.98

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 487.4με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by: James Deutsch

Calibrated on: 28-Aug-2009

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2