Pile Dynamics, Inc.

Transducer 804W

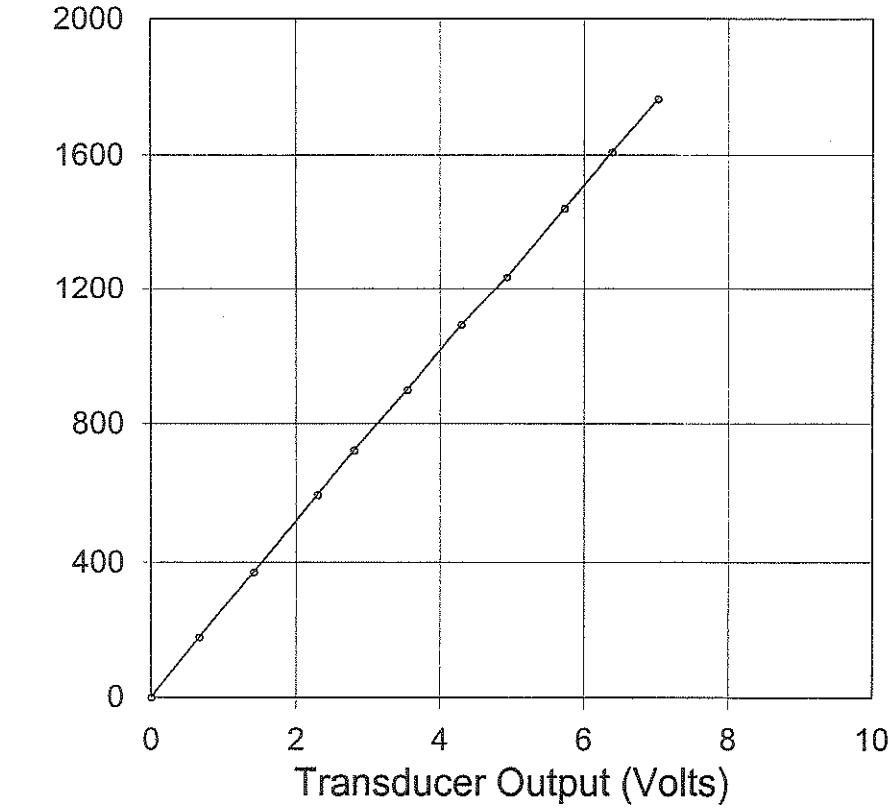

PDA Cal Factor (5.0 V) 125.0με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
181	0.66
371	1.41
594	2.29
721	2.80
897	3.54
1090	4.30
1236	4.92
1442	5.72
1609	6.38
1765	7.02

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 434.1με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by: James Deutdorff

Calibrated on: 02-Jul-2007

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2