Pile Dynamics, Inc.

Transducer 805W

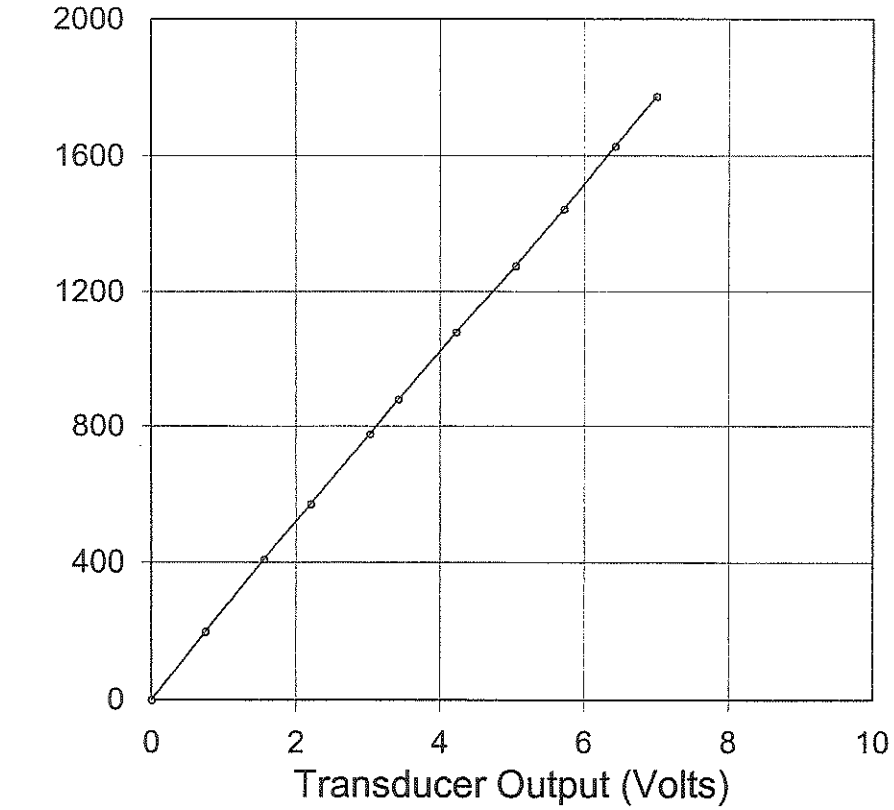

PDA Cal Factor (5.0 V) 125.8με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
202	0.74
408	1.55
568	2.20
777	3.03
879	3.42
1078	4.22
1275	5.05
1445	5.71
1628	6.42
1774	7.00

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 437.0με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by: James A. Deutsch

Calibrated on: 02-Jul-2007

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2