Pile Dynamics, Inc.

Transducer 806W

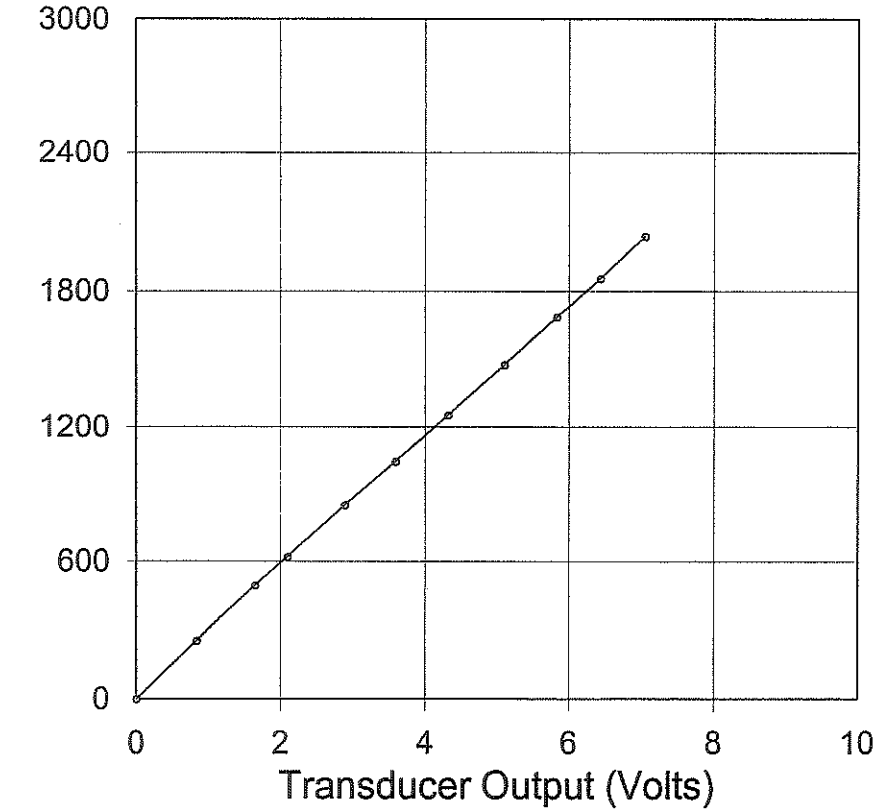

PDA Cal Factor (5.0 V) 143.4με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
256	0.83
496	1.64
618	2.09
849	2.88
1045	3.58
1252	4.31
1476	5.09
1686	5.82
1856	6.43
2036	7.05

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 498.0με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 09-Jul-2007

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2