Pile Dynamics, Inc.

Transducer 810W

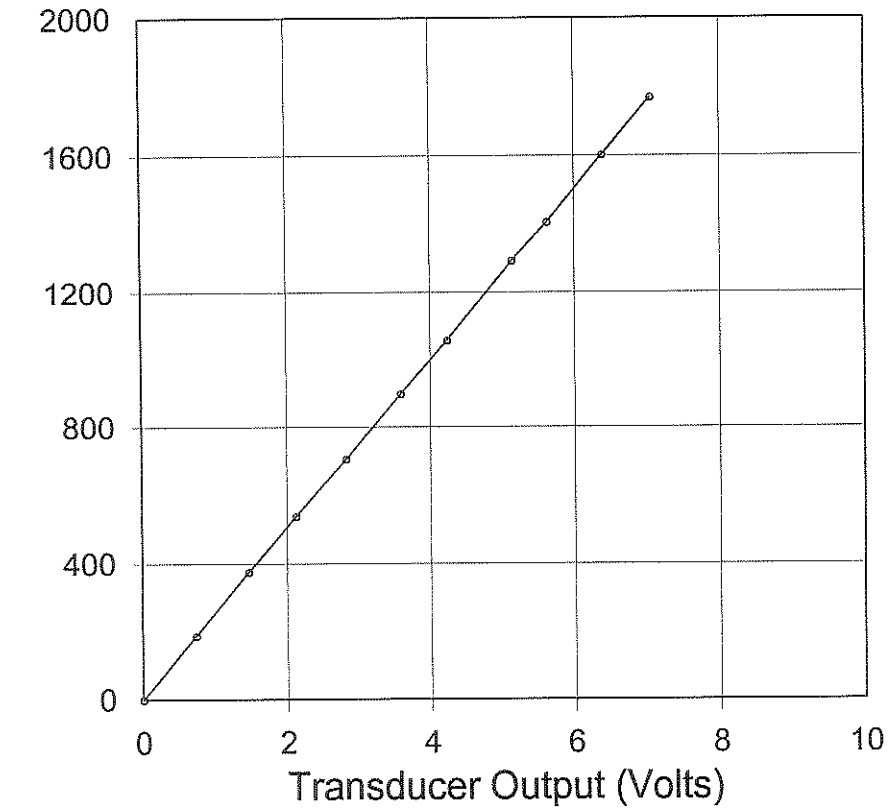

PDA Cal Factor (5.0 V) 125.1με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
190	0.73
376	1.46
539	2.12
704	2.81
896	3.58
1057	4.23
1292	5.13
1406	5.62
1603	6.39
1770	7.05

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 434.3με/mV/V

Calibrated by: James Dentcheff

Calibrated on: 28-Aug-2009

Traceable to N.I.S.T.

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2