Pile Dynamics, Inc.

Transducer 812W

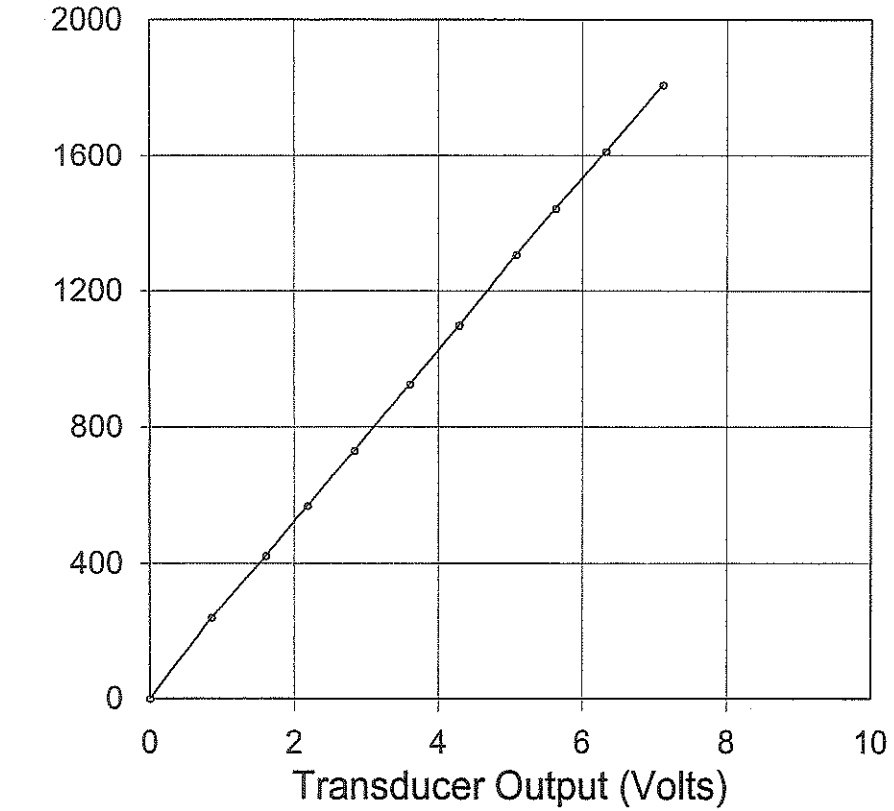

PDA Cal Factor (5.0 V) 126.9με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
236	0.85
421	1.60
568	2.18
731	2.83
925	3.60
1098	4.28
1304	5.07
1442	5.62
1615	6.33
1813	7.11

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 440.7με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 05-Jul-2007

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2