Pile Dynamics, Inc.

Transducer 814W

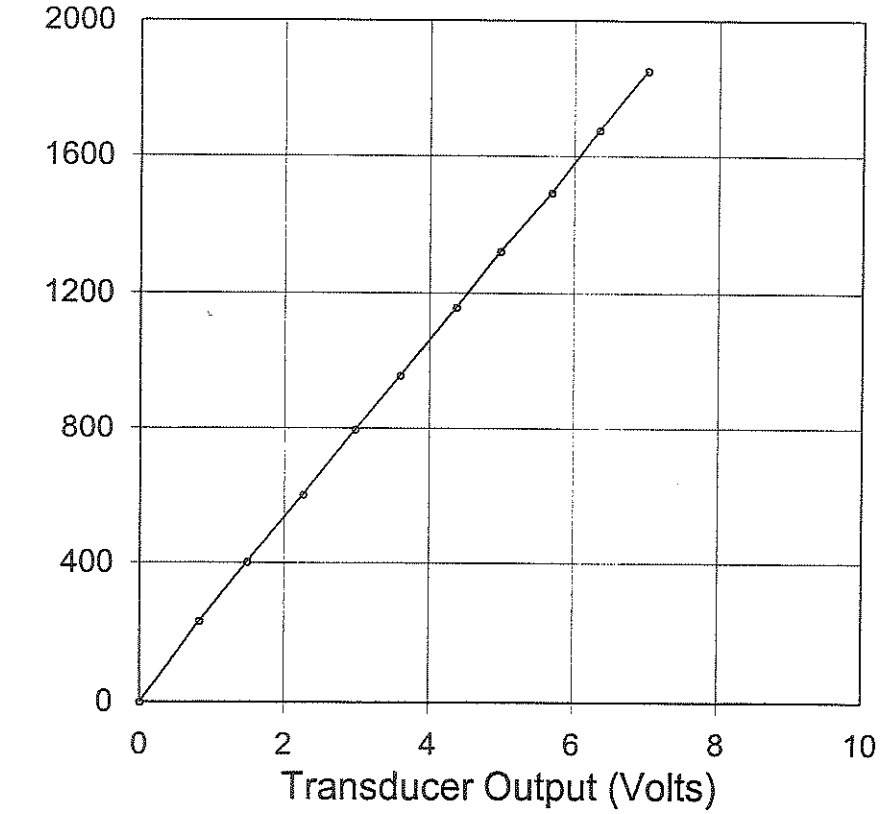

PDA Cal Factor (5.0 V) 131.4με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
233	0.82
402	1.48
601	2.25
795	2.97
957	3.59
1160	4.37
1322	4.98
1493	5.68
1675	6.35
1853	7.01

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 456.1με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by: James Deutsch

Calibrated on: 16-Jul-2007

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2