Pile Dynamics, Inc.

Transducer 815W

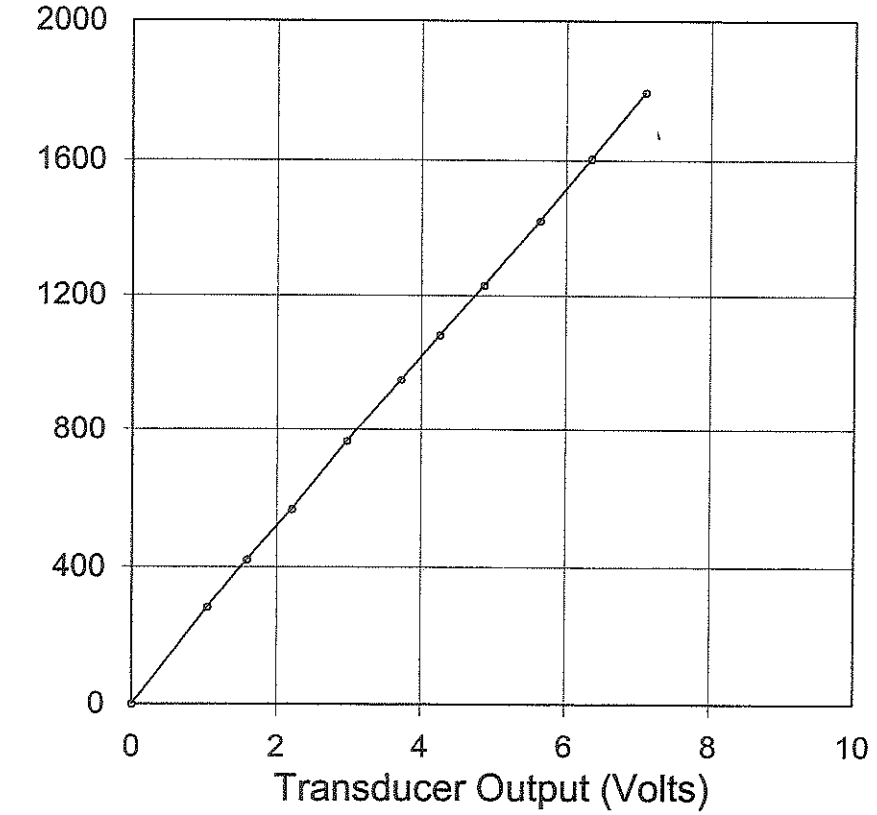

PDA Cal Factor (5.0 V) 125.5με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
284	1.04
420	1.59
566	2.20
765	2.96
949	3.71
1081	4.25
1231	4.86
1423	5.63
1606	6.34
1795	7.09

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 435.6με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by: Jon Courtoff

Calibrated on: 10-Jul-2007

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2