Pile Dynamics, Inc.

Pile Dynamics, Inc.

Transducer 816W

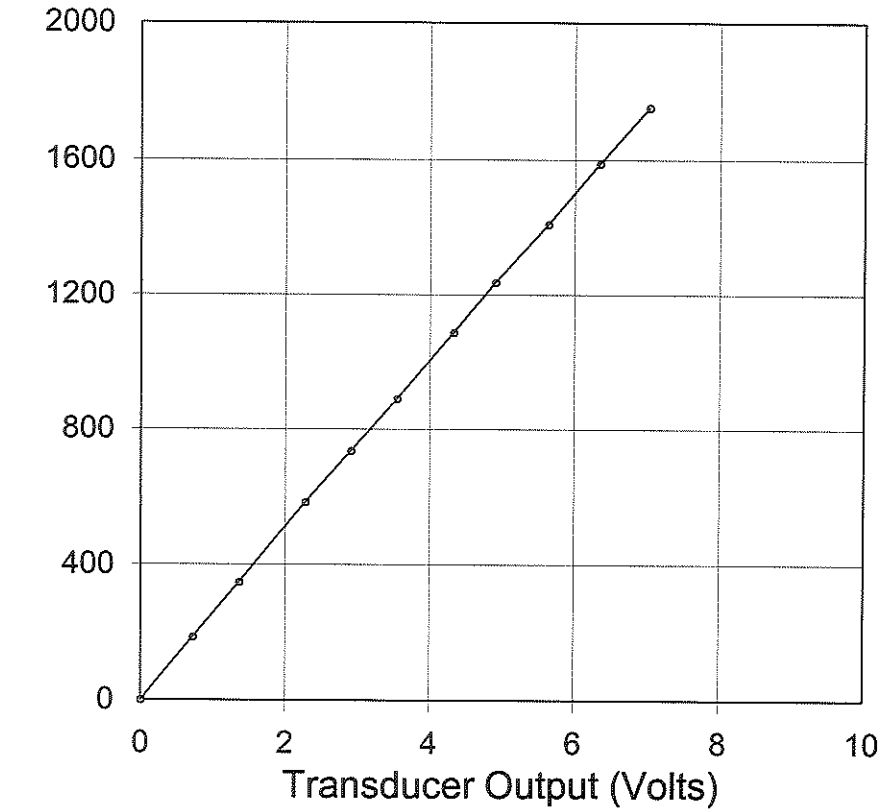

PDA Cal Factor (5.0 V) 124.8με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
188	0.72
348	1.36
582	2.27
736	2.90
891	3.54
1088	4.32
1237	4.90
1411	5.63
1590	6.34
1754	7.02

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 433.2με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 06-Feb-2009

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2