Pile Dynamics, Inc.

Transducer 817W

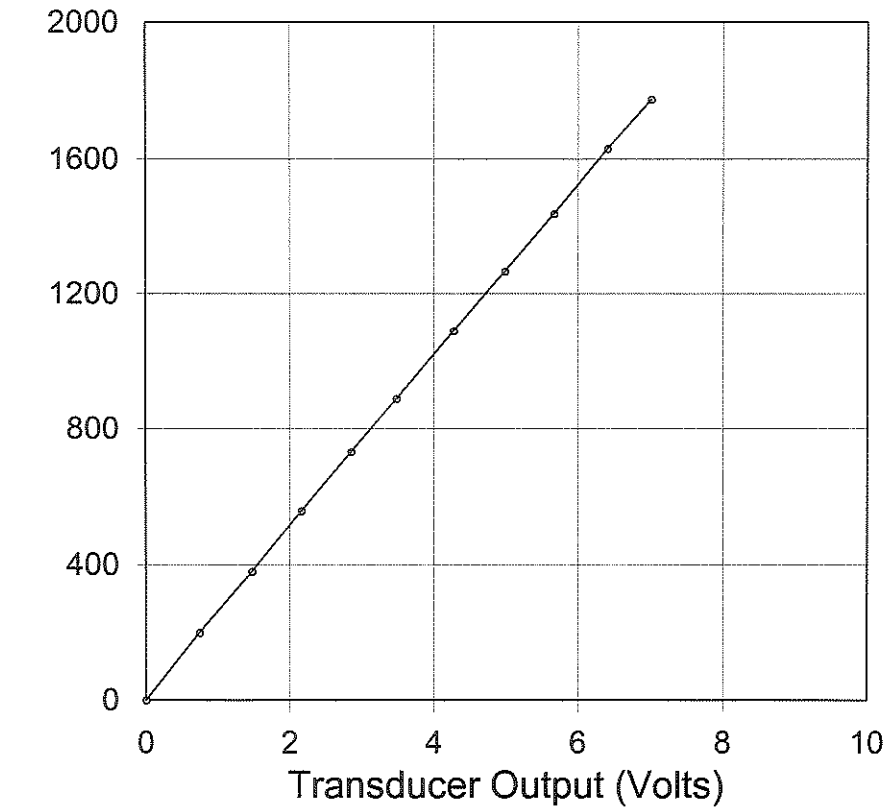

PDA Cal Factor (5.0 V) 126.4με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
199	0.74
381	1.47
557	2.16
731	2.85
890	3.48
1089	4.27
1268	4.98
1437	5.66
1630	6.40
1777	7.01

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 439.0με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 05-Feb-2009

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2