Pile Dynamics, Inc.

Transducer 818W

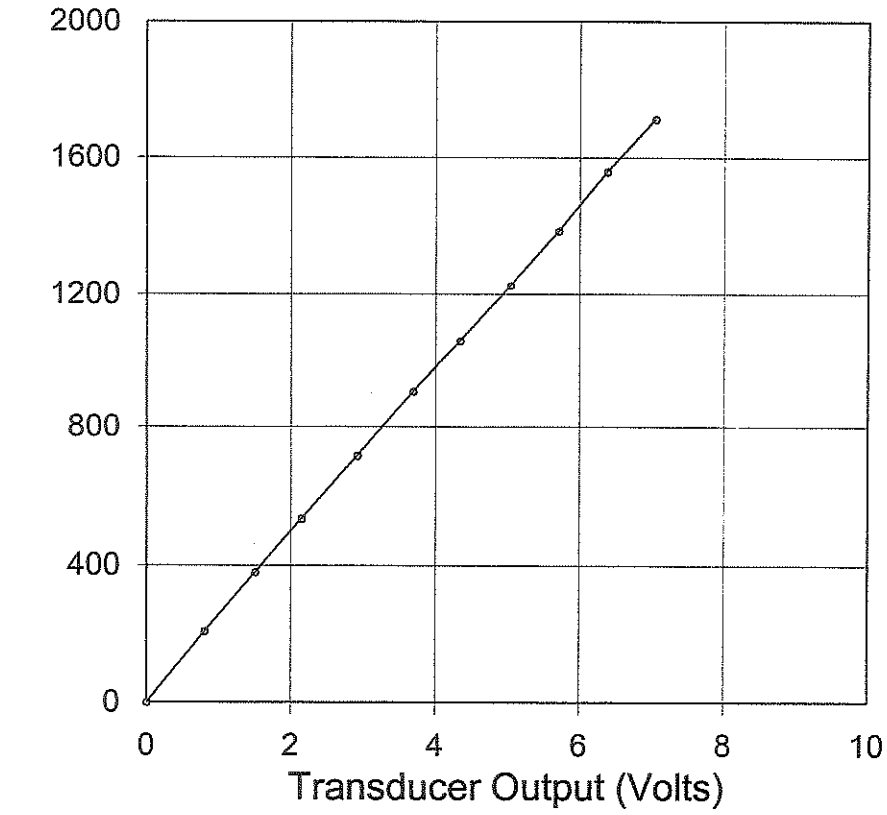

PDA Cal Factor (5.0 V) 121.2με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
208	0.80
379	1.50
531	2.14
714	2.91
906	3.68
1058	4.33
1227	5.03
1388	5.70
1559	6.37
1714	7.04

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 421.0με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by: James Dunlap

Calibrated on: 10-Jul-2007

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2