Pile Dynamics, Inc.

Transducer 832W

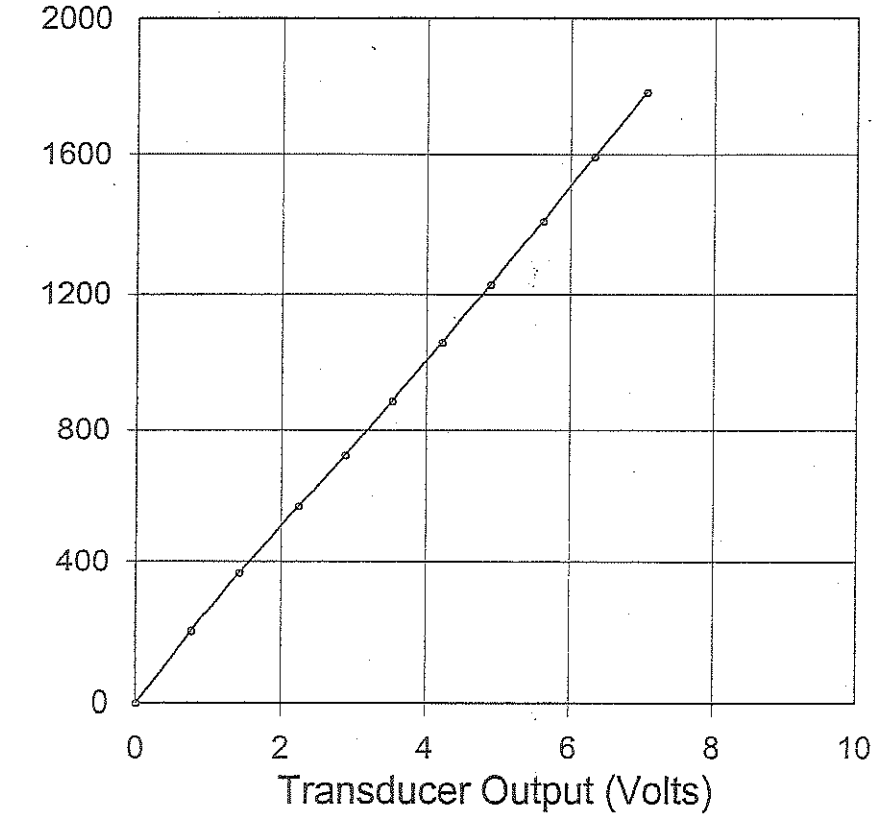

PDA Cal Factor (5.0 V) 125.8με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
201	0.76
365	1.42
568	2.23
722	2.87
886	3.52
1057	4.21
1228	4.88
1410	5.61
1594	6.32
1784	7.05

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 436.7με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 11-Jun-2008

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2