Pile Dynamics, Inc.

Transducer 835W

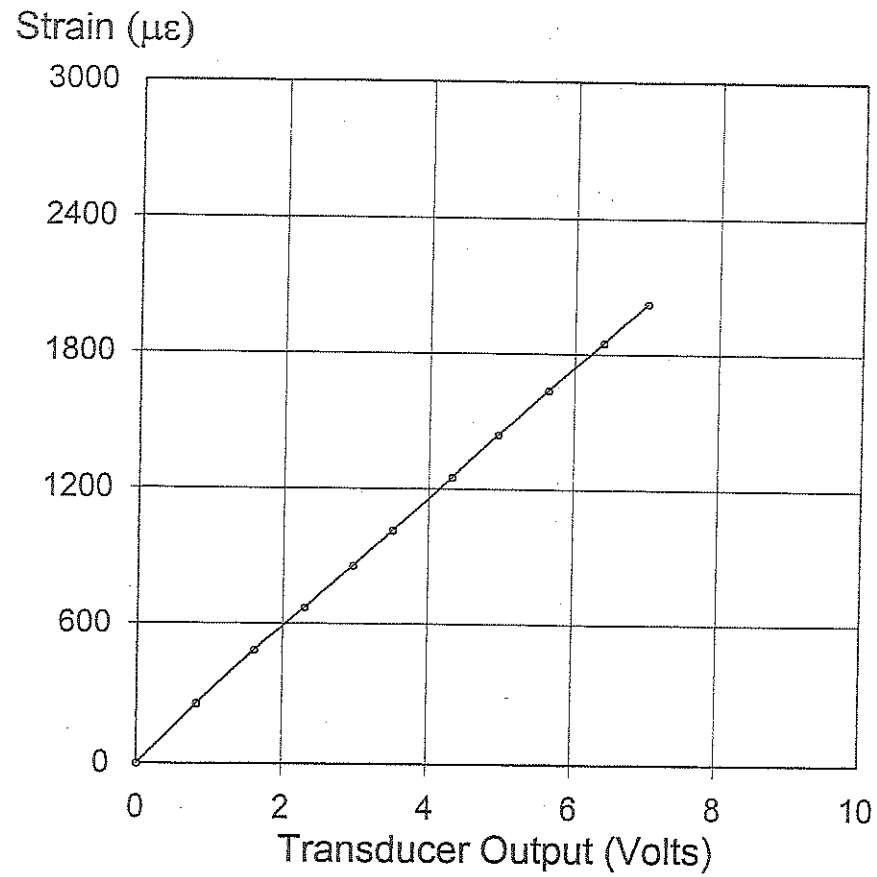

PDA Cal Factor (5.0 V) 143.6με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
256	0.82
482	1.60
671	2.30
858	2.95
1015	3.50
1248	4.31
1432	4.94
1631	5.63
1848	6.39
2023	7.00

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 498.7με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by: _____

Calibrated on: 23-Jun-2008

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2