Pile Dynamics, Inc.

Transducer 837W

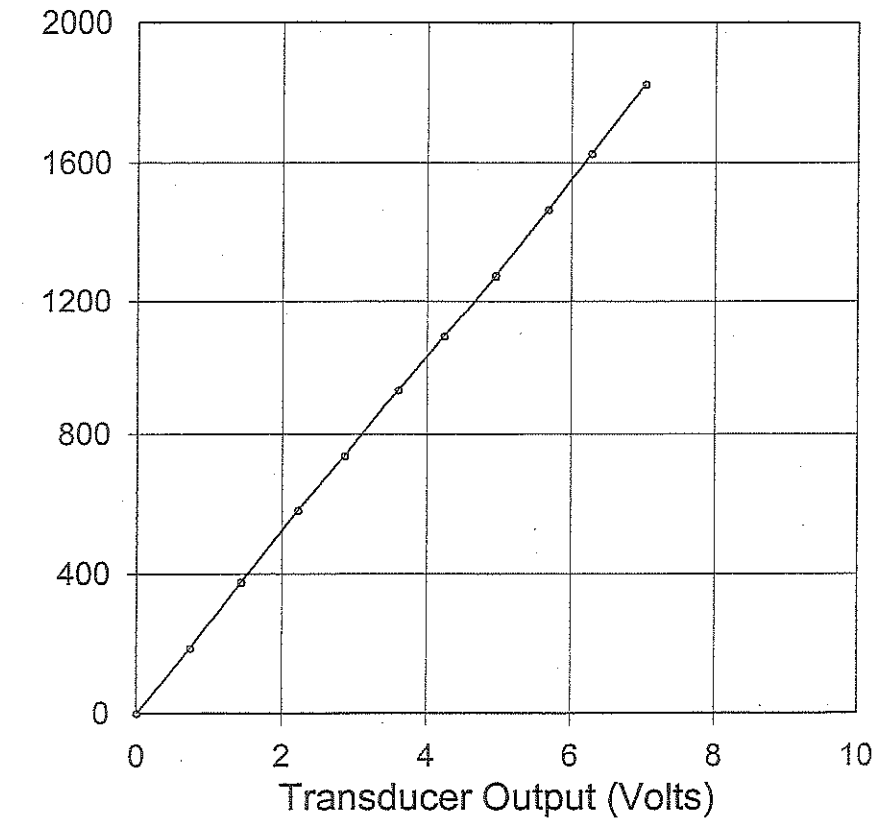

PDA Cal Factor (5.0 V) 129.3με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
192	0.73
376	1.43
579	2.21
736	2.85
930	3.59
1089	4.23
1274	4.94
1468	5.67
1627	6.27
1823	7.02

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 449.1με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 11-Jun-2008

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2