Pile Dynamics, Inc.

Transducer 838W

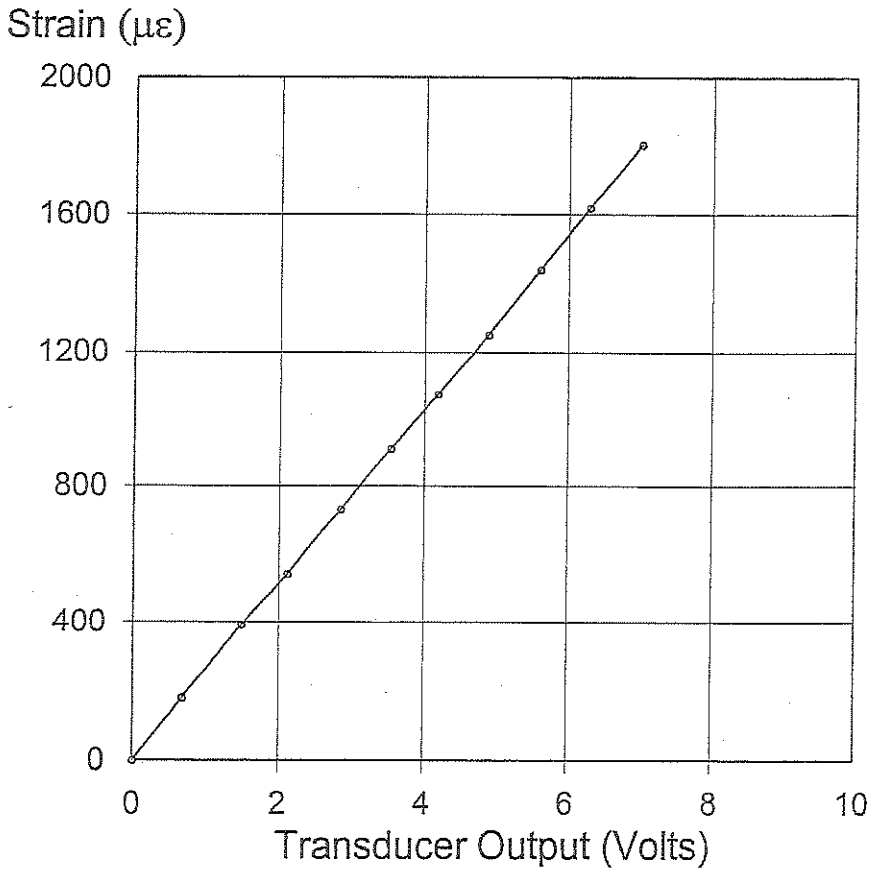

PDA Cal Factor (5.0 V) 128.4με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
180	0.67
390	1.48
542	2.11
734	2.84
909	3.53
1073	4.18
1251	4.88
1438	5.60
1620	6.28
1807	7.00

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 445.8με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 11-Jun-2008

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2