Pile Dynamics, Inc.

Transducer 840W

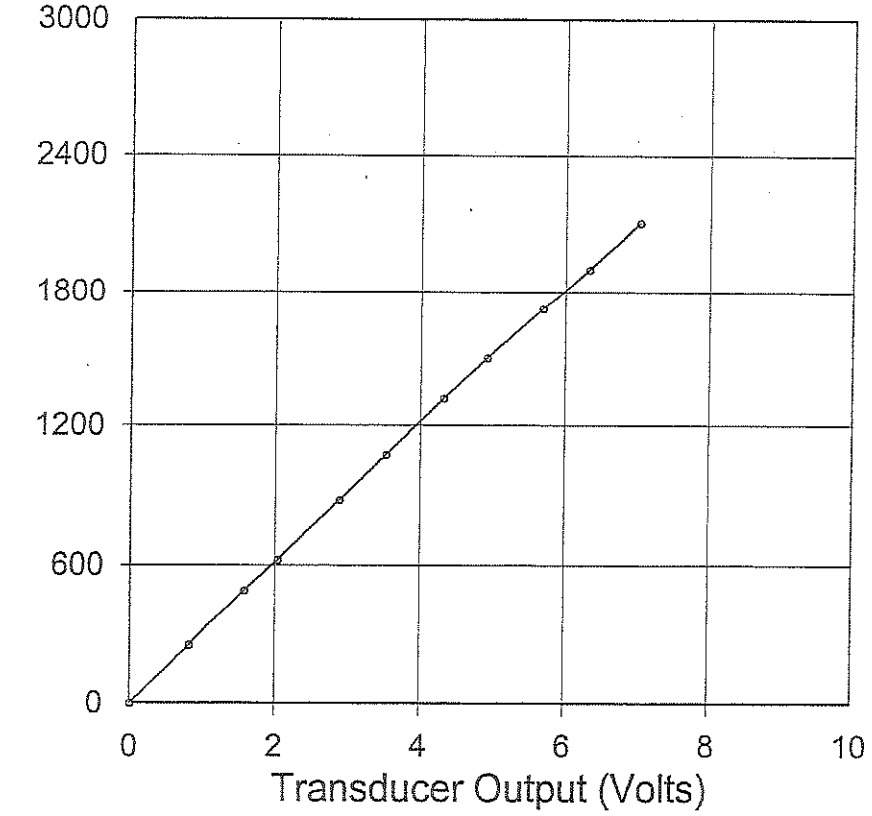

PDA Cal Factor (5.0 V) 150.0με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
258	0.81
491	1.58
623	2.03
881	2.88
1073	3.52
1315	4.31
1498	4.91
1724	5.68
1901	6.32
2109	7.02

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 520.7με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 11-Jun-2008

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2