Pile Dynamics, Inc.

Transducer 842W

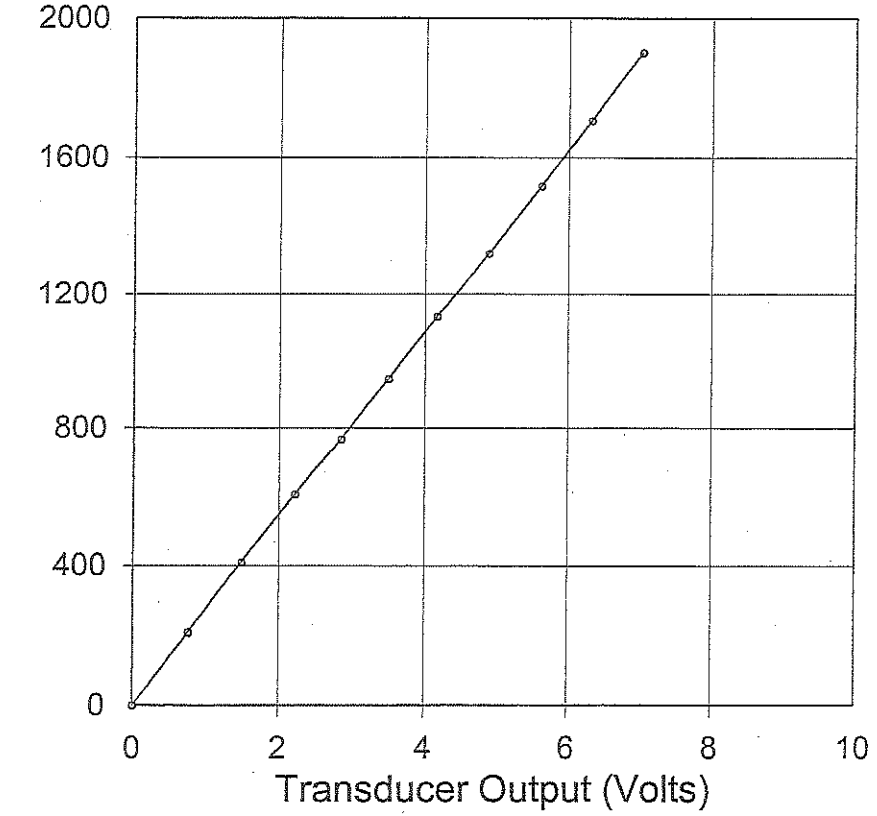

PDA Cal Factor (5.0 V) 135.0με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
210	0.75
411	1.48
605	2.21
768	2.84
944	3.49
1131	4.16
1322	4.88
1518	5.61
1710	6.31
1901	7.02

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 468.8με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 11-Jun-2008

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2