Pile Dynamics, Inc.

Transducer 843W

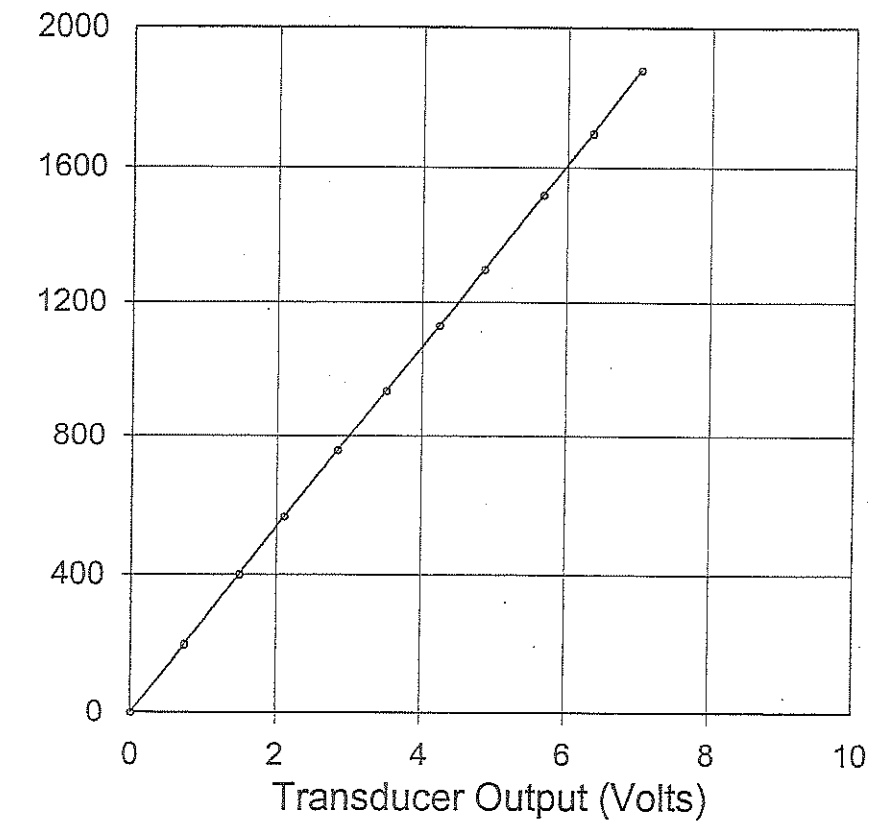

PDA Cal Factor (5.0 V) 133.9με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
201	0.73
399	1.48
565	2.10
757	2.83
935	3.50
1126	4.23
1297	4.85
1518	5.66
1701	6.35
1883	7.01

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 464.9με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 11-Jun-2008

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2