Pile Dynamics, Inc.

Transducer 844W

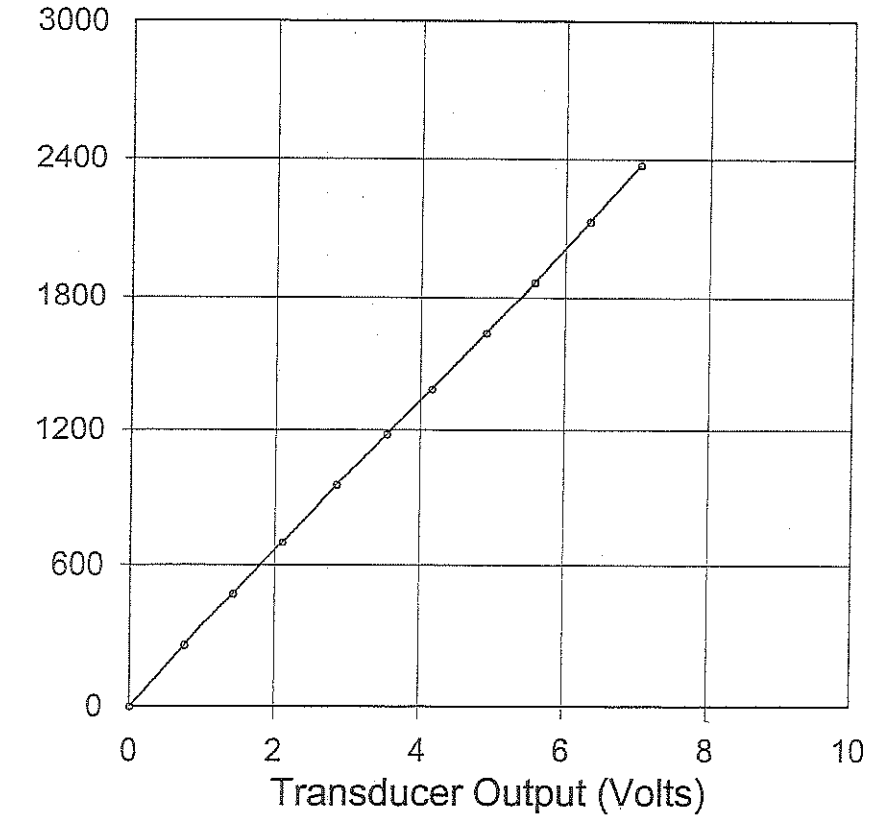

PDA Cal Factor (5.0 V) 168.1με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
263	0.75
478	1.41
697	2.10
953	2.84
1181	3.53
1384	4.14
1636	4.90
1867	5.56
2127	6.33
2374	7.03

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 583.5με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 11-Jun-2008

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2