Pile Dynamics, Inc.

Transducer 845W

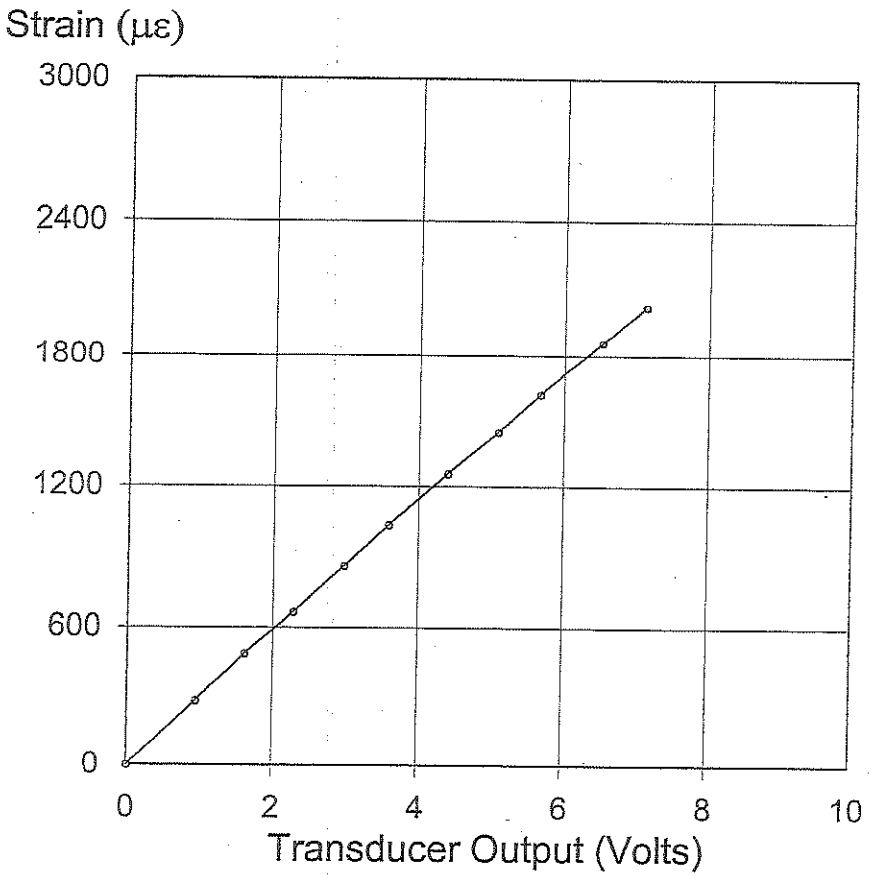

PDA Cal Factor (5.0 V) 141.3με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
284	0.93
484	1.61
664	2.27
858	2.97
1033	3.58
1254	4.40
1443	5.08
1614	5.66
1863	6.52
2024	7.12

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 490.5με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 24-Jun-2008

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2