Pile Dynamics, Inc.

Transducer 846W

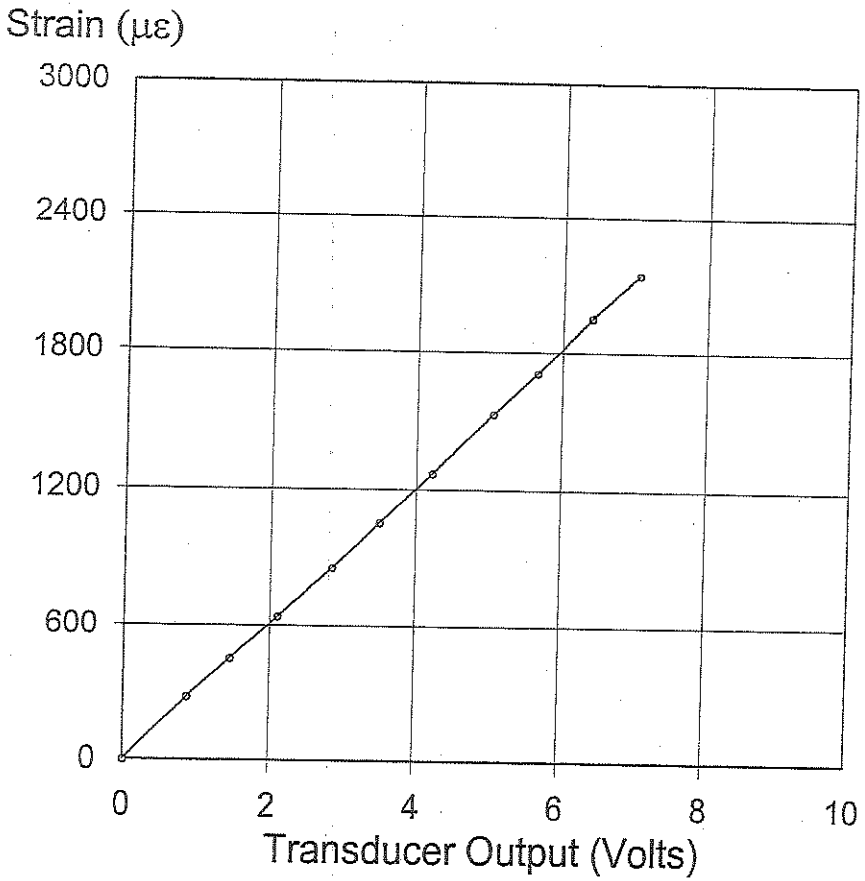

PDA Cal Factor (5.0 V) 151.1με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
274	0.86
447	1.45
639	2.10
855	2.84
1054	3.49
1268	4.21
1524	5.04
1702	5.65
1946	6.39
2137	7.04

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 524.5με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by: _____

Calibrated on: 24-Jun-2008

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2