Pile Dynamics, Inc.

Transducer 848W

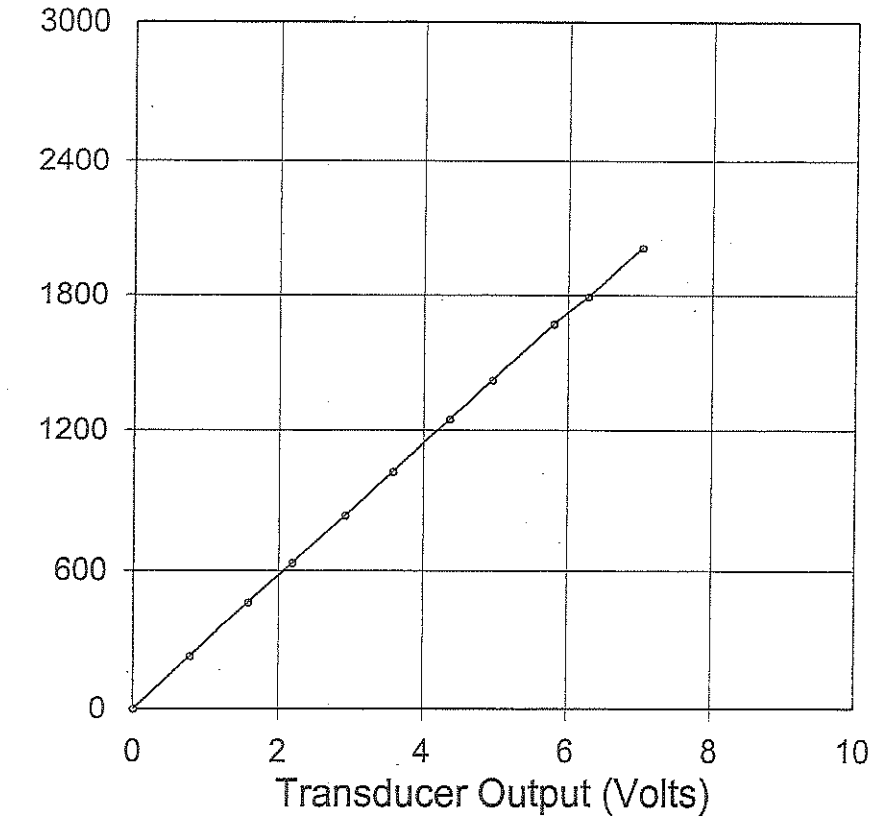

PDA Cal Factor (5.0 V) 142.4με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
235	0.77
461	1.58
632	2.18
837	2.91
1019	3.57
1248	4.35
1419	4.94
1663	5.79
1794	6.27
2007	7.02

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 494.5με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by: James Tenkoff

Calibrated on: 23-Jun-2008

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2