Pile Dynamics, Inc.

Transducer 851W

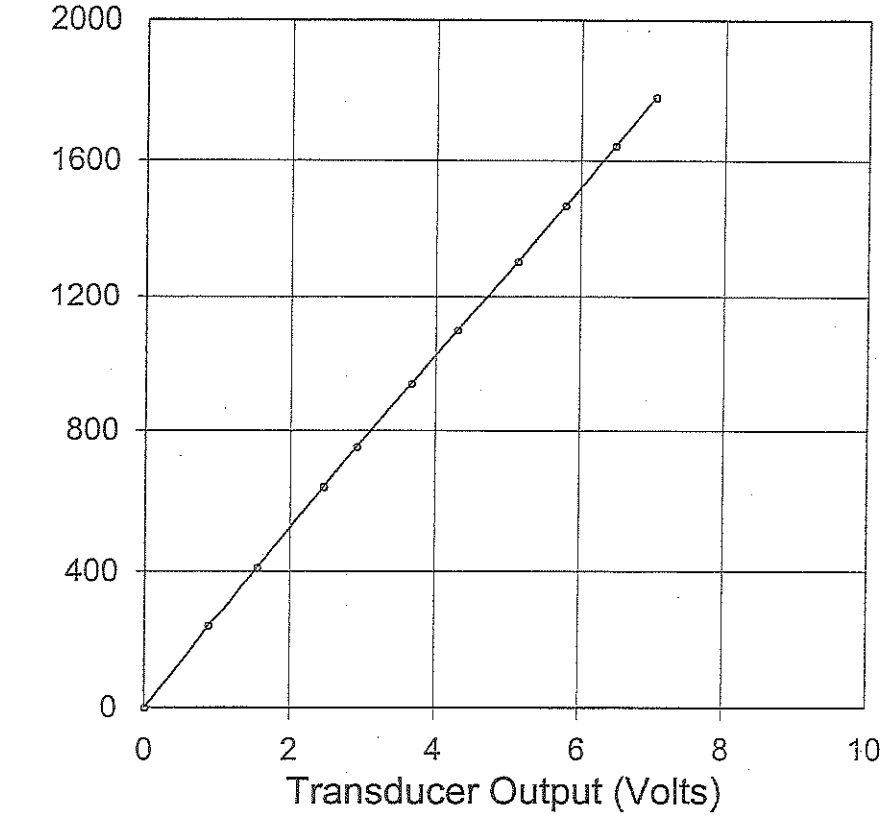

PDA Cal Factor (5.0 V) 126.0με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
242	0.88
411	1.54
637	2.46
752	2.91
936	3.66
1096	4.29
1303	5.12
1469	5.78
1645	6.47
1783	7.03

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 437.4με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by: Jimmy Stanford

Calibrated on: 23-Jun-2008

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2