Pile Dynamics, Inc.

Transducer 853W

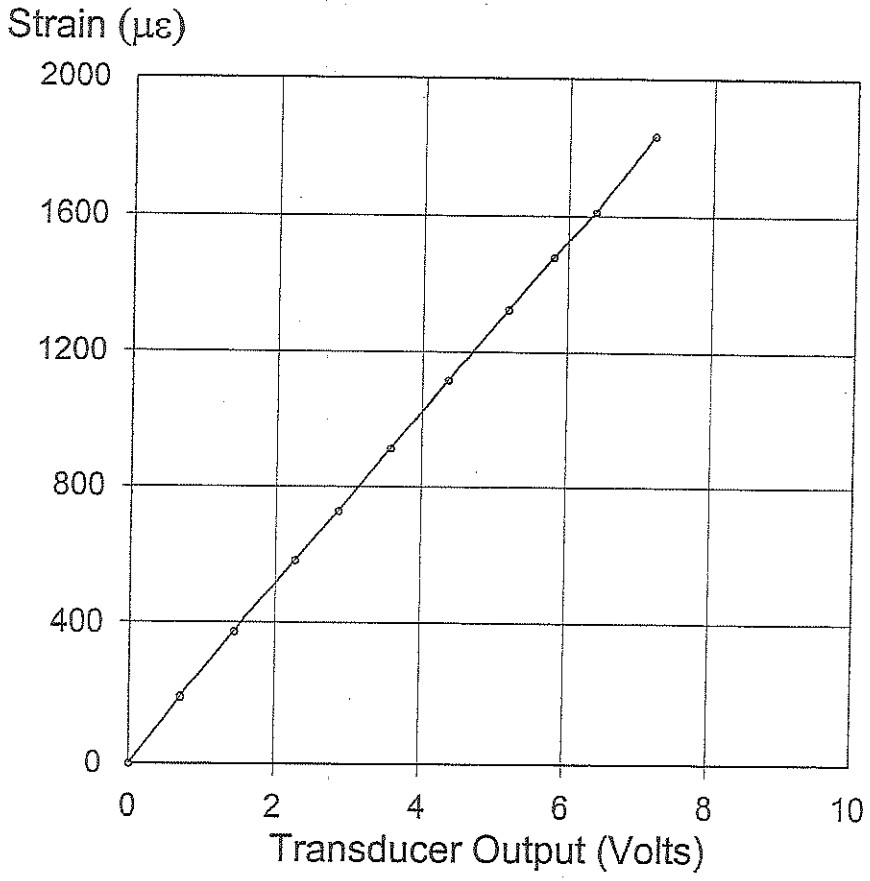

PDA Cal Factor (5.0 V) 126.9με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
191	0.70
376	1.43
584	2.26
729	2.85
913	3.56
1114	4.35
1329	5.17
1481	5.80
1615	6.37
1834	7.19

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 440.6με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by: _____

Calibrated on: 23-Jun-2008

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2