Pile Dynamics, Inc.

Transducer 854W

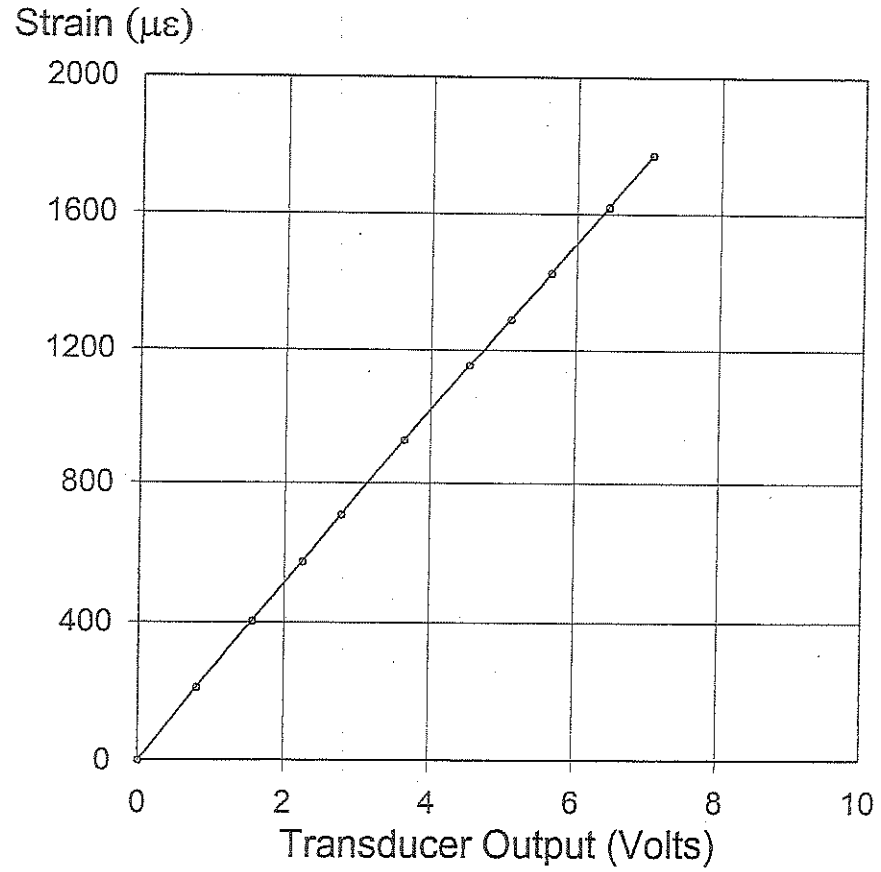

PDA Cal Factor (5.0 V) 125.4με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
212	0.79
404	1.55
574	2.24
708	2.77
925	3.63
1151	4.52
1292	5.09
1428	5.64
1619	6.43
1774	7.04

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 435.5με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 23-Jun-2008

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2