Pile Dynamics, Inc.

Transducer 855W

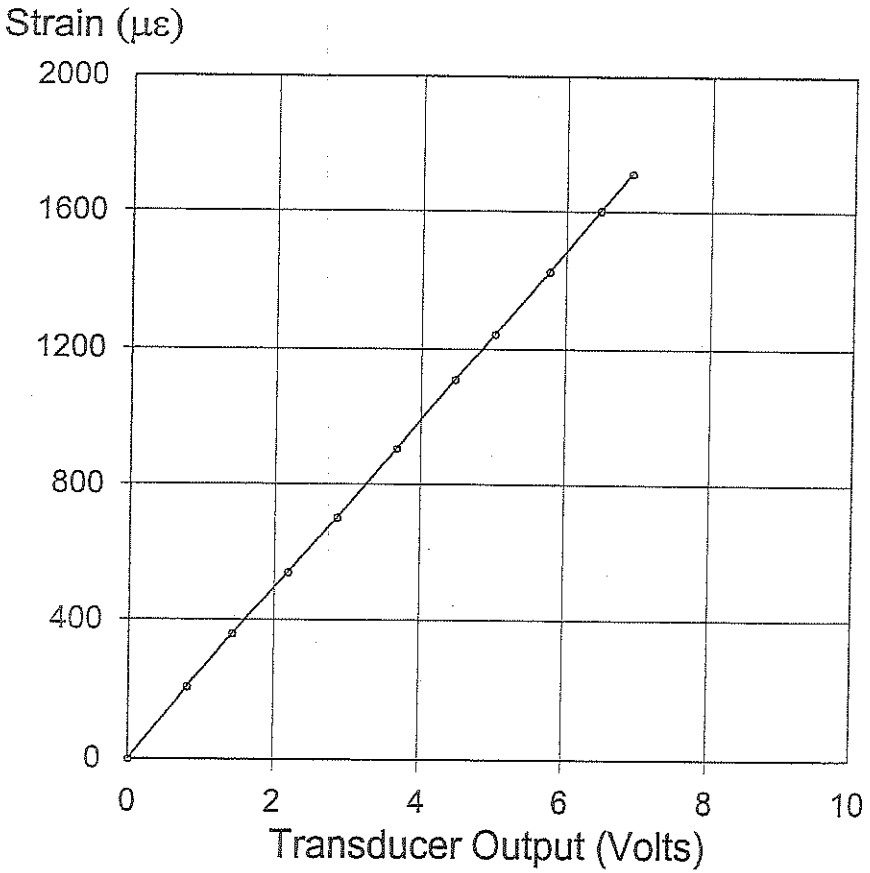

PDA Cal Factor (5.0 V) 123.8με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
208	0.80
358	1.42
540	2.18
701	2.84
906	3.66
1107	4.46
1243	5.01
1425	5.76
1603	6.46
1714	6.90

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 429.8με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 23-Jun-2008

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2