Pile Dynamics, Inc.

Transducer 856W

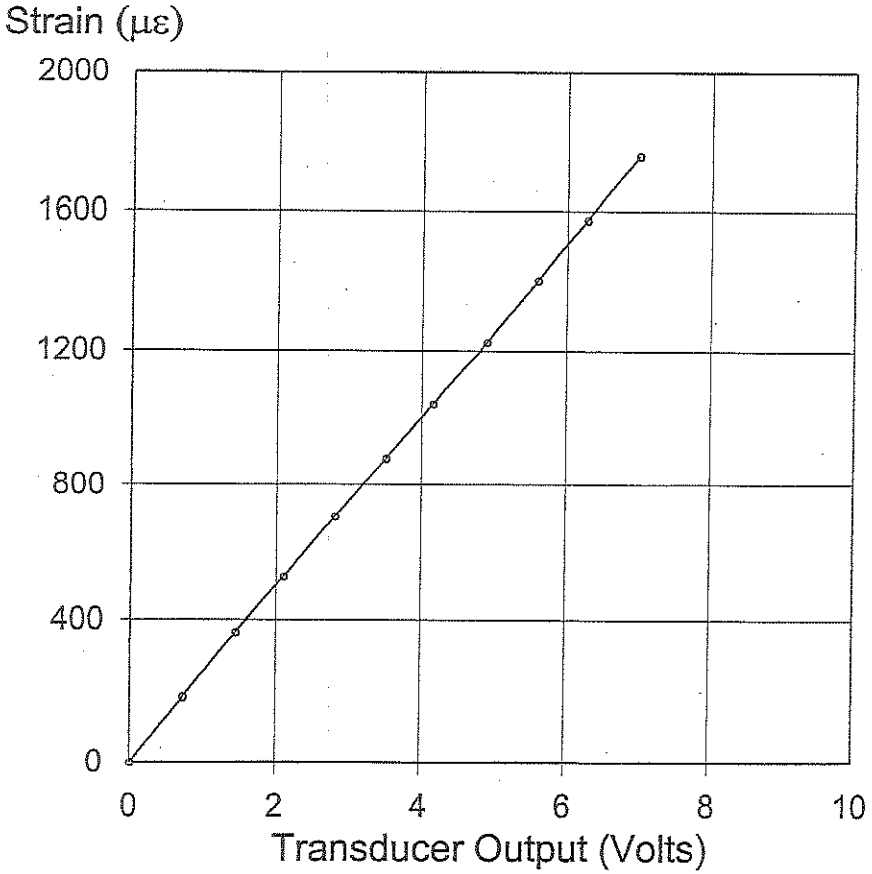

PDA Cal Factor (5.0 V) 125.3με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
186	0.71
365	1.44
526	2.10
703	2.80
877	3.50
1038	4.15
1224	4.89
1403	5.59
1577	6.27
1757	6.99

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 435.1με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by: _____

Calibrated on: 18-Jun-2008

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2