Pile Dynamics, Inc.

Transducer 857W

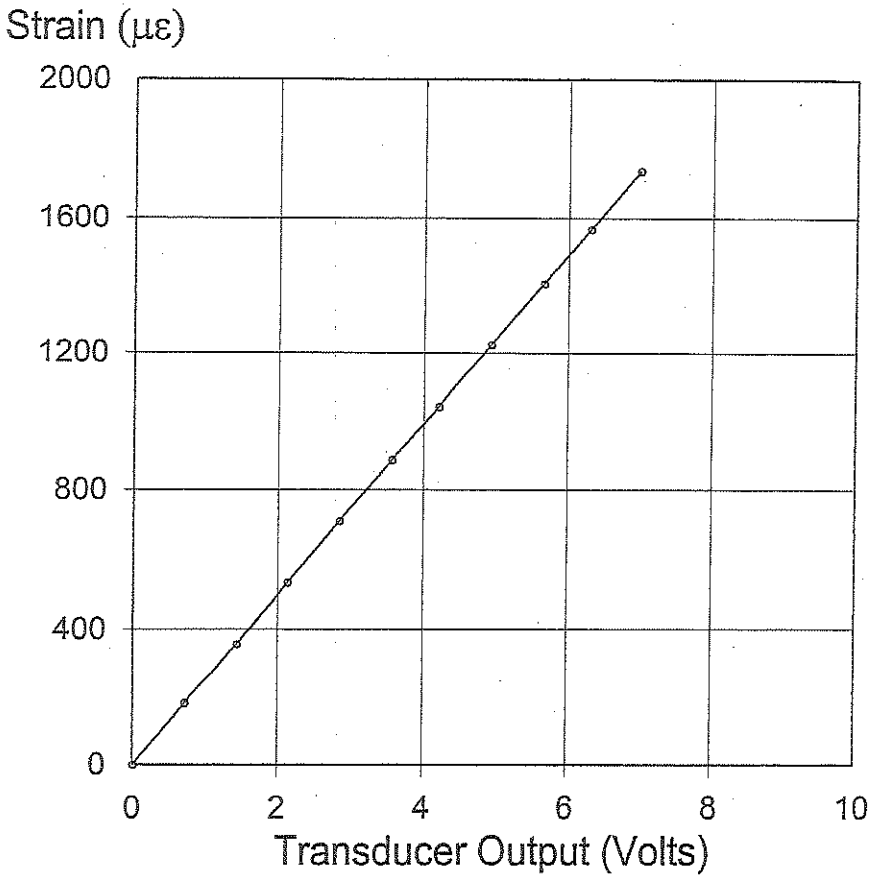

PDA Cal Factor (5.0 V) 124.0με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
186	0.71
356	1.42
533	2.13
710	2.84
884	3.56
1040	4.20
1224	4.92
1405	5.65
1566	6.30
1738	6.99

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 430.5με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 18-Jun-2008

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2