Pile Dynamics, Inc.

Transducer 858W

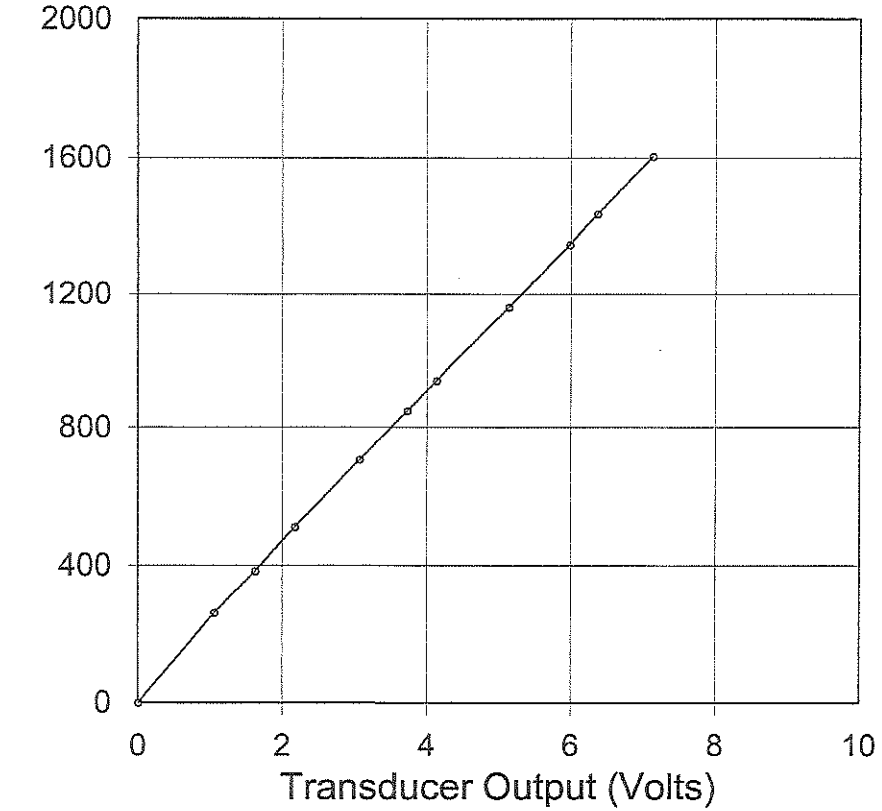

PDA Cal Factor (5.0 V) 111.4με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
262	1.06
385	1.62
510	2.17
705	3.06
846	3.73
939	4.13
1162	5.14
1347	5.97
1435	6.36
1605	7.14

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 386.8με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by: [signature]

Calibrated on: 25-Jul-2008

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2