Pile Dynamics, Inc.

Transducer 859W

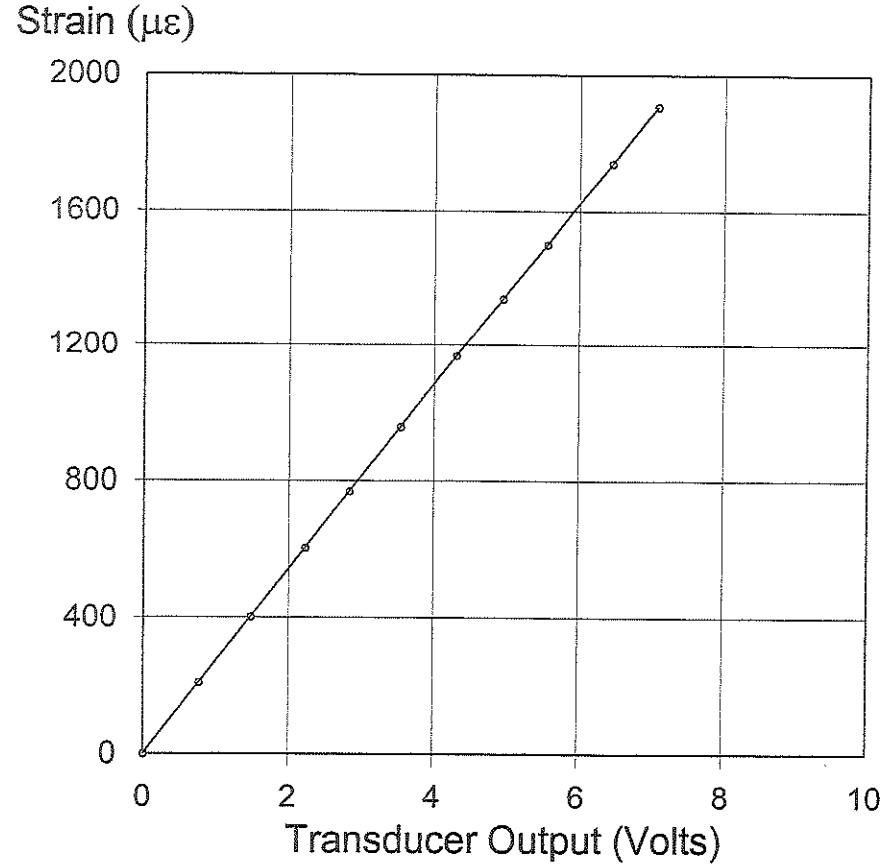

PDA Cal Factor (5.0 V) 135.2με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
211	0.76
401	1.47
604	2.22
769	2.83
957	3.53
1167	4.30
1341	4.94
1505	5.54
1746	6.45
1911	7.07

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 469.5με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by: James Dewitch

Calibrated on: 26-Aug-2008

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2