Pile Dynamics, Inc.

Transducer 860W

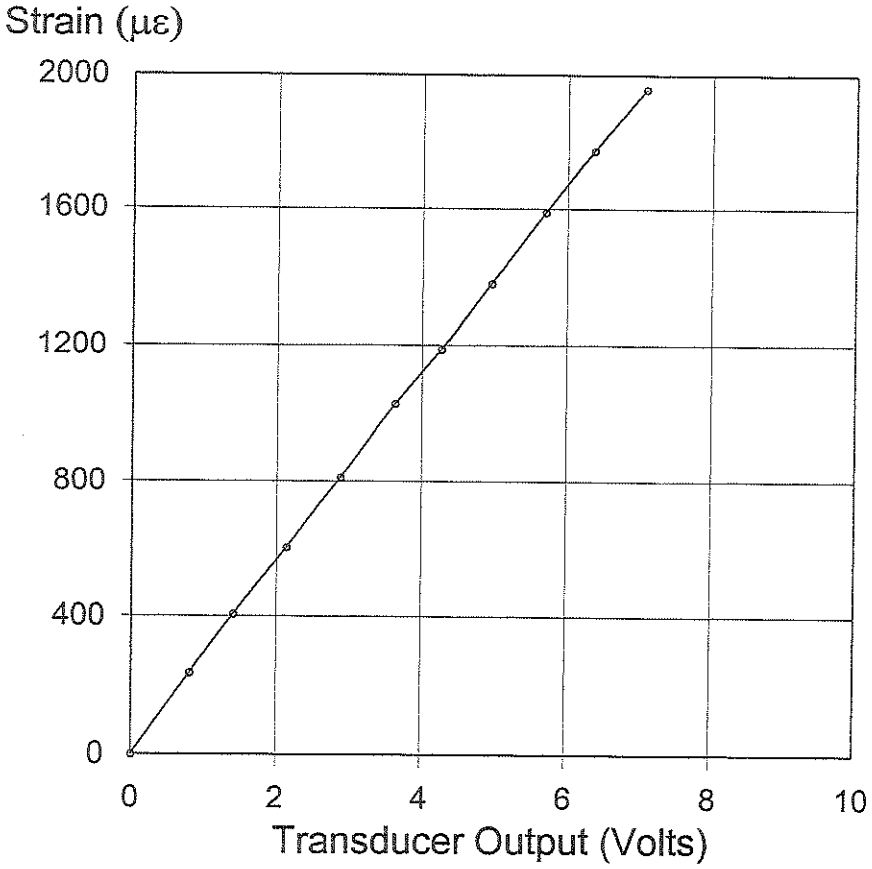

PDA Cal Factor (5.0 V) 138.4με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
239	0.80
405	1.40
602	2.13
811	2.87
1026	3.63
1188	4.26
1383	4.95
1589	5.69
1776	6.36
1959	7.07

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 480.5με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by: James Deutsch

Calibrated on: 26-Aug-2008

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2