Pile Dynamics, Inc.

Transducer 861W

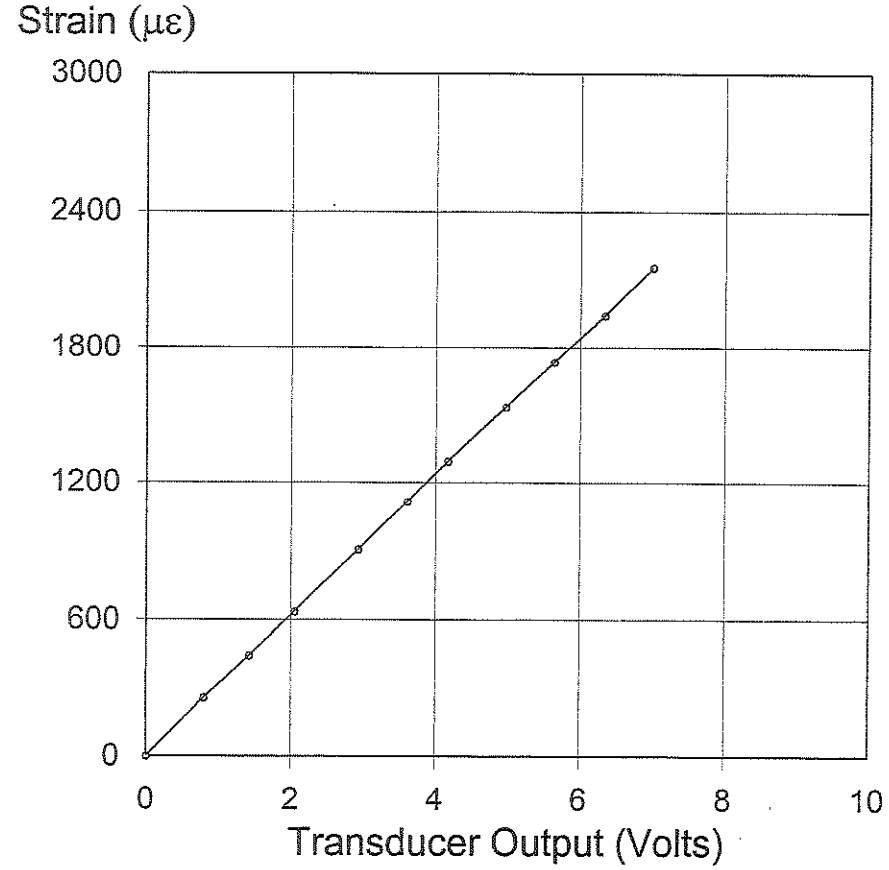

PDA Cal Factor (5.0 V) 153.5με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
262	0.80
445	1.41
635	2.04
908	2.92
1114	3.60
1295	4.16
1536	4.96
1737	5.63
1948	6.33
2159	7.00

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 532.8με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by: James Deutsch

Calibrated on: 26-Aug-2008

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2