Pile Dynamics, Inc.

Transducer 863W

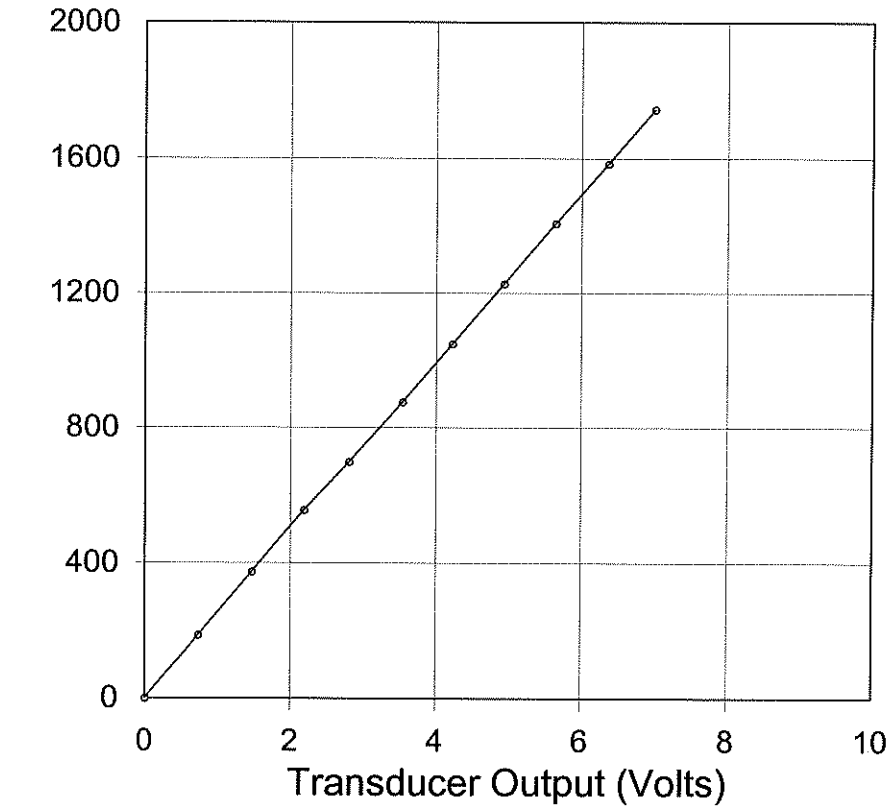

PDA Cal Factor (5.0 V) 124.1με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
187	0.72
374	1.46
555	2.18
698	2.80
876	3.53
1050	4.22
1228	4.93
1408	5.64
1586	6.36
1746	7.00

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 431.0με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 18-May-2010

Strain Transducer Calibrator System 2009 Version 1.3