Pile Dynamics, Inc.

Transducer 865W

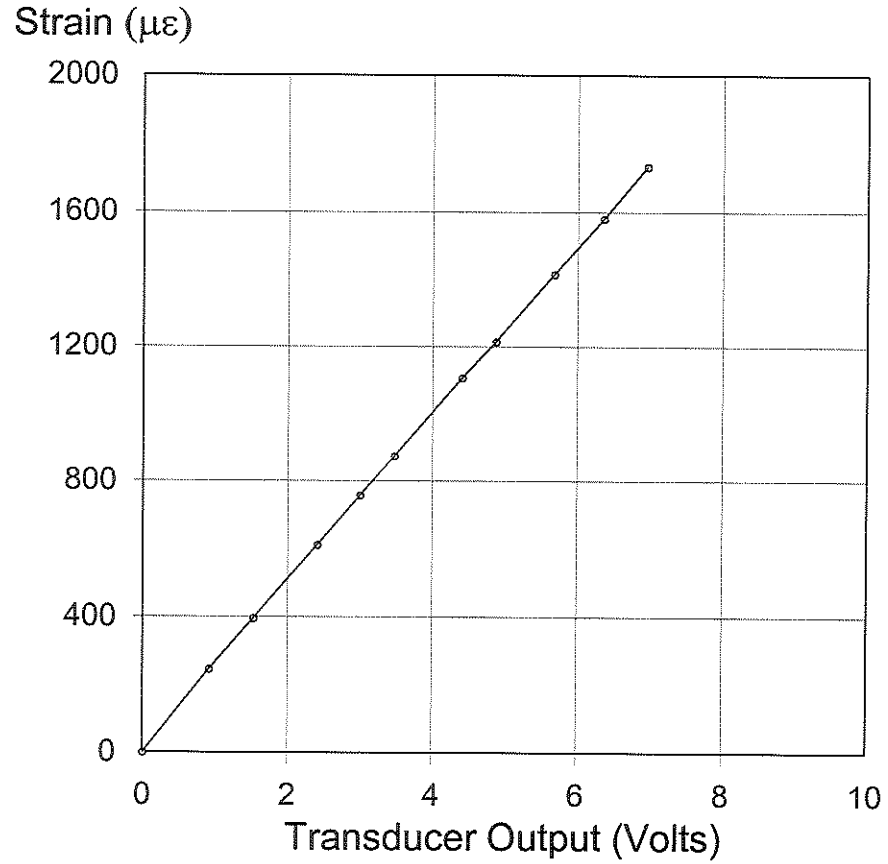

PDA Cal Factor (5.0 V) 123.8με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
245	0.91
395	1.52
610	2.40
756	2.99
874	3.47
1107	4.40
1216	4.87
1417	5.68
1581	6.35
1734	6.95

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 429.9με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 30-Mar-2009

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2