Pile Dynamics, Inc.

Transducer 866W

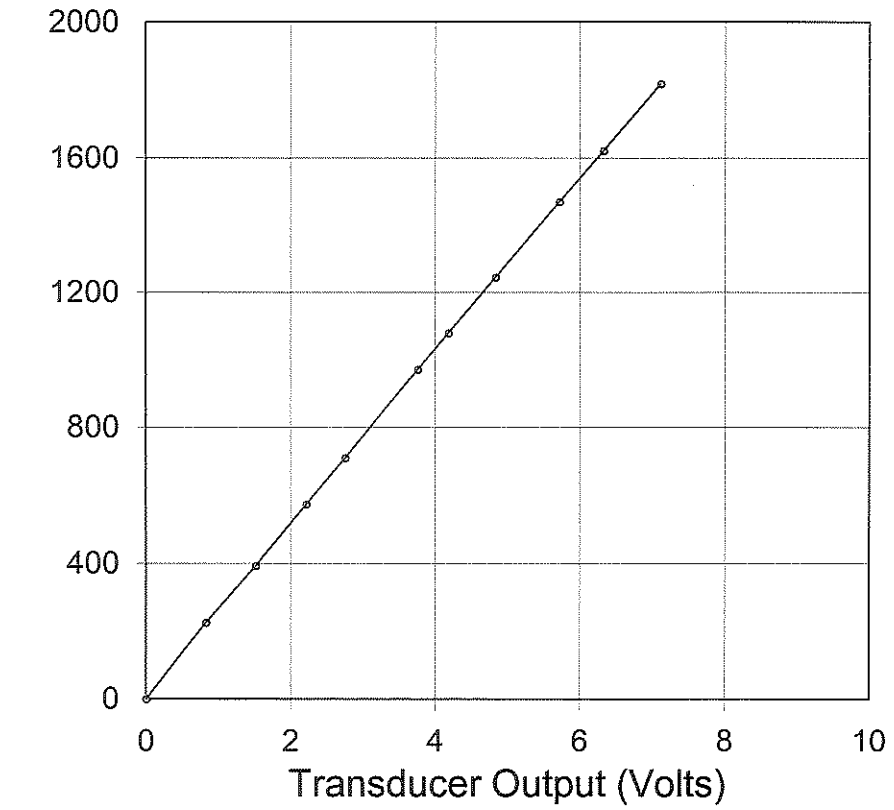

PDA Cal Factor (5.0 V) 127.7με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
227	0.82
393	1.51
573	2.21
710	2.75
971	3.75
1080	4.18
1246	4.83
1470	5.71
1623	6.33
1819	7.11

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 443.5με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by: James Smith

Calibrated on: 30-Mar-2009

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2