Pile Dynamics, Inc.

Transducer 867W

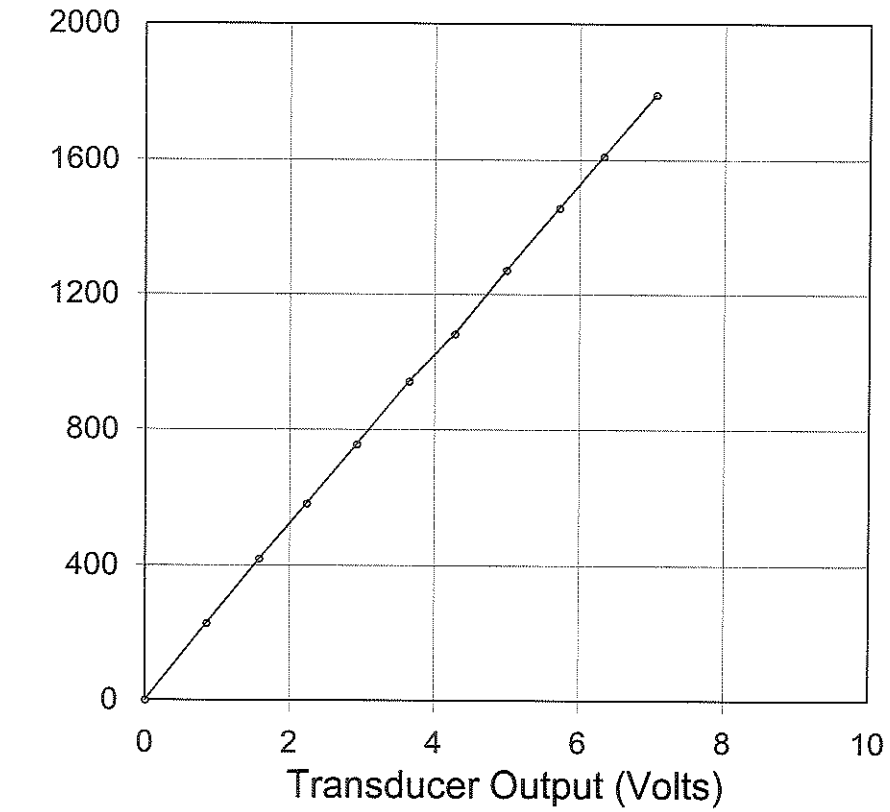

PDA Cal Factor (5.0 V) 126.5με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
229	0.84
418	1.57
580	2.23
756	2.92
943	3.65
1084	4.27
1272	4.98
1459	5.71
1611	6.32
1794	7.05

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 439.2με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 30-Mar-2009

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2