Pile Dynamics, Inc.

Transducer 868W

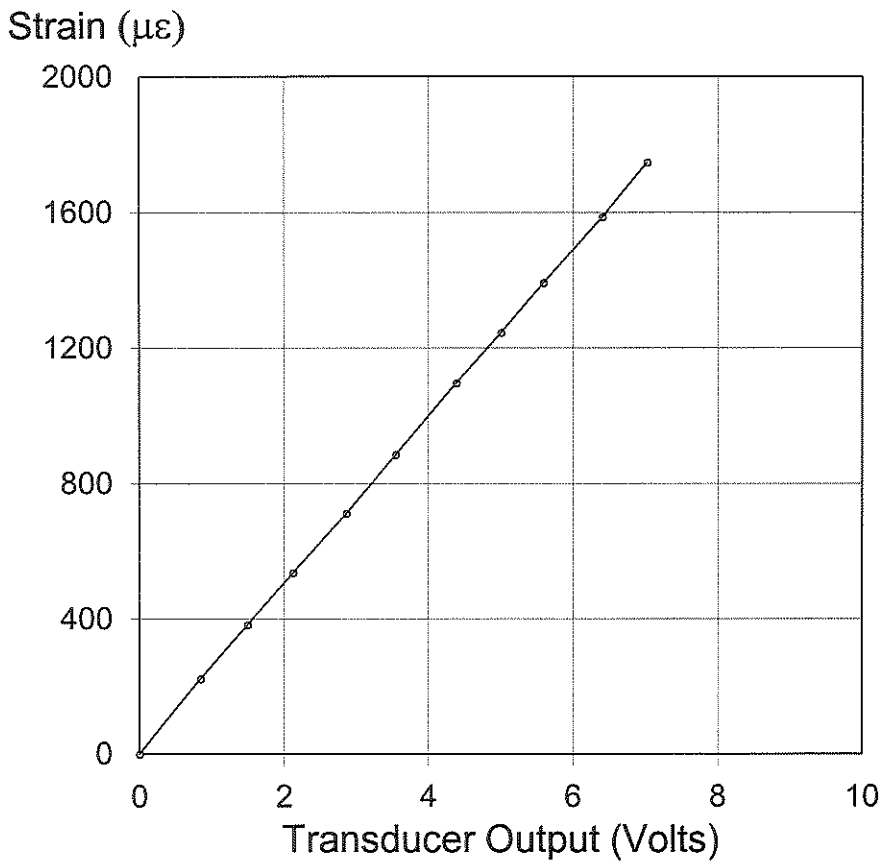

PDA Cal Factor (5.0 V) 123.7με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
222	0.84
381	1.49
536	2.12
712	2.86
883	3.54
1096	4.38
1246	5.00
1392	5.59
1588	6.40
1748	7.02

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 429.5με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by: [signature]

Calibrated on: 30-Mar-2009

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2