Pile Dynamics, Inc.

Transducer 870W

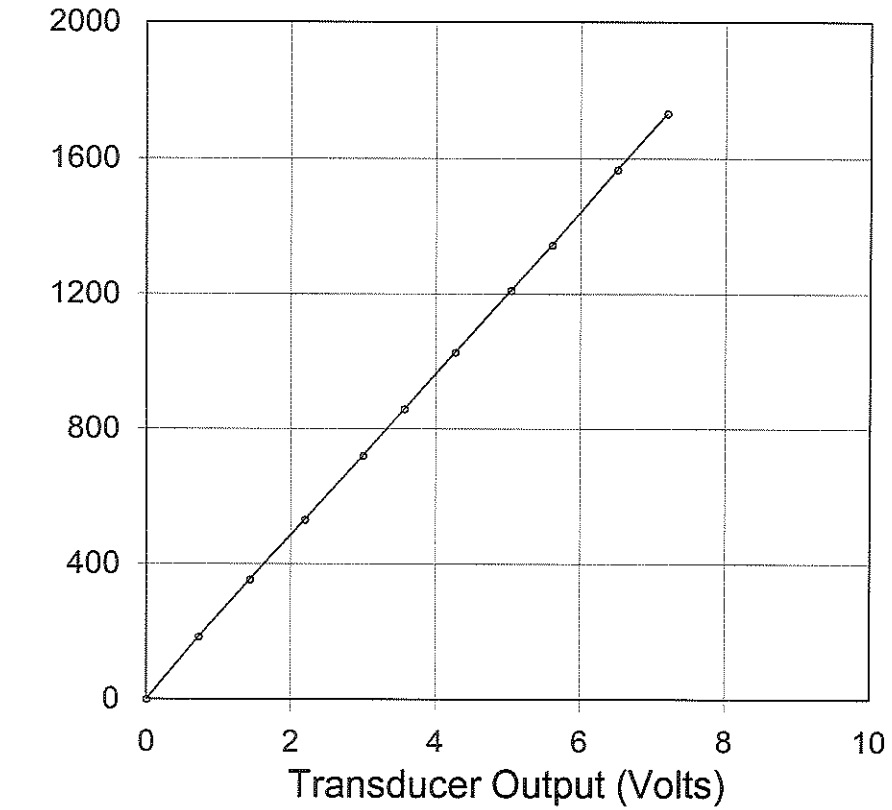

PDA Cal Factor (5.0 V) 119.9με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
185	0.72
354	1.43
529	2.19
719	3.00
858	3.56
1026	4.26
1211	5.03
1346	5.59
1567	6.51
1732	7.19

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 416.4με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by: James Deutsch

Calibrated on: 30-Mar-2009

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2