Pile Dynamics, Inc.

Transducer 871W

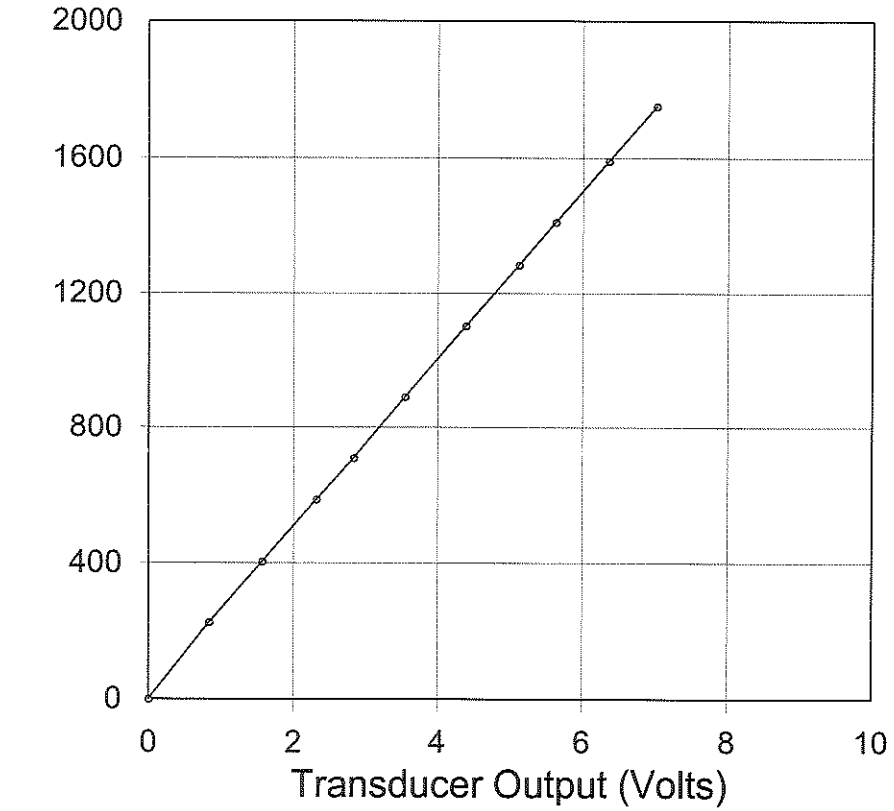

PDA Cal Factor (5.0 V) 124.5με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
227	0.83
405	1.56
585	2.31
710	2.83
890	3.54
1103	4.38
1285	5.12
1413	5.62
1593	6.35
1752	7.01

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 432.5με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by: James Deutsch

Calibrated on: 30-Mar-2009

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2