Pile Dynamics, Inc.

Transducer 874W

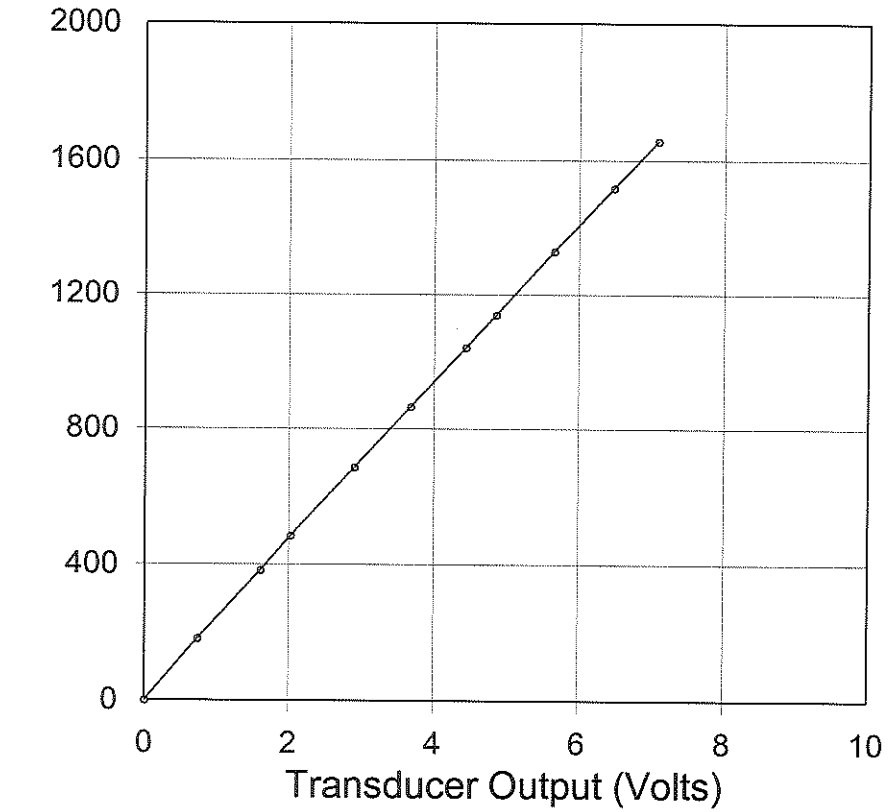

PDA Cal Factor (5.0 V) 116.7με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
183	0.73
381	1.60
483	2.02
684	2.90
865	3.68
1043	4.43
1140	4.84
1329	5.65
1519	6.47
1658	7.08

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 405.3με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 30-Mar-2009

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2