Pile Dynamics, Inc.

Transducer 875W

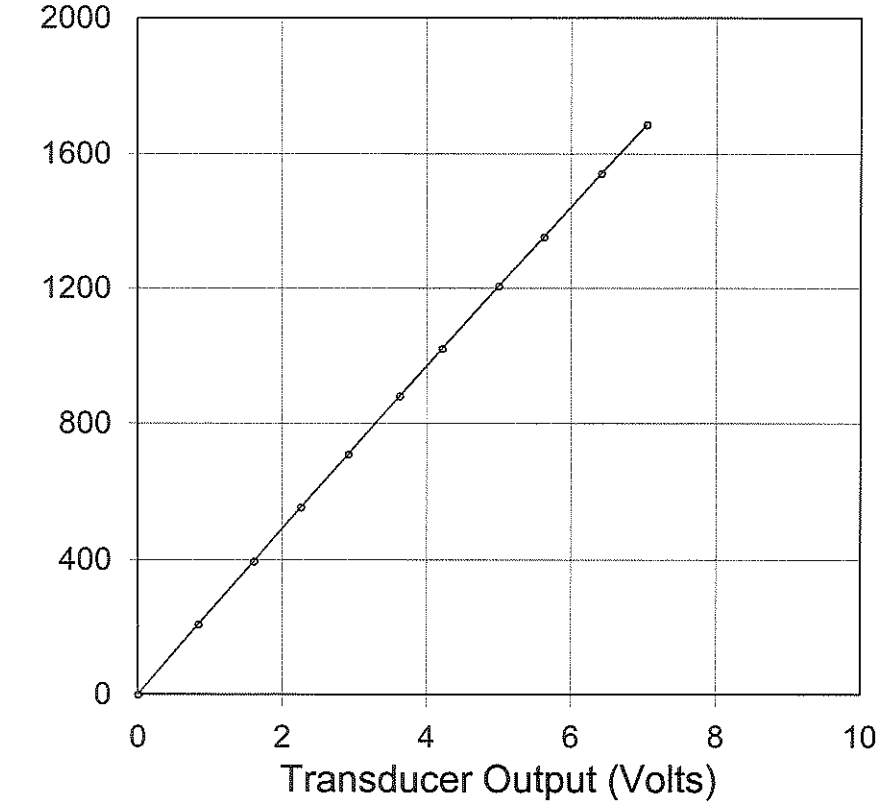

PDA Cal Factor (5.0 V) 119.6με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
208	0.83
395	1.60
553	2.25
710	2.91
881	3.62
1020	4.21
1207	4.99
1355	5.62
1542	6.41
1688	7.04

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 415.4με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 30-Mar-2009

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2