Pile Dynamics, Inc.

Transducer 877W

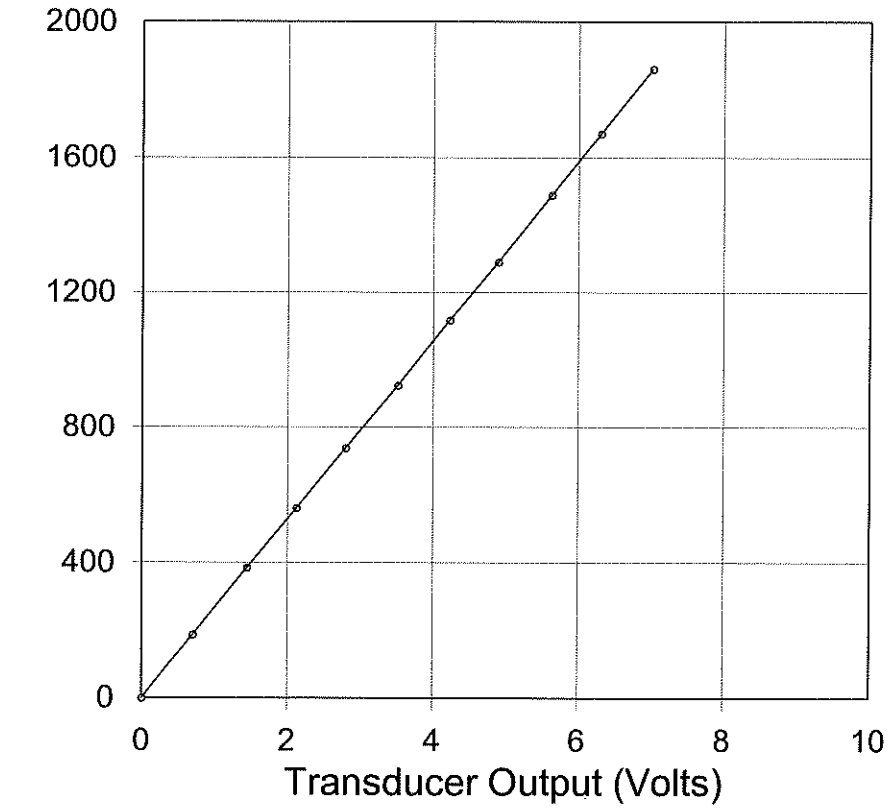

PDA Cal Factor (5.0 V) 132.5με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
186	0.69
384	1.44
559	2.12
738	2.80
924	3.51
1117	4.22
1292	4.89
1490	5.62
1671	6.30
1862	7.02

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 460.2με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 29-Jun-2010

Strain Transducer Calibrator System 2009 Version 1.3