Pile Dynamics, Inc.

Transducer 883W

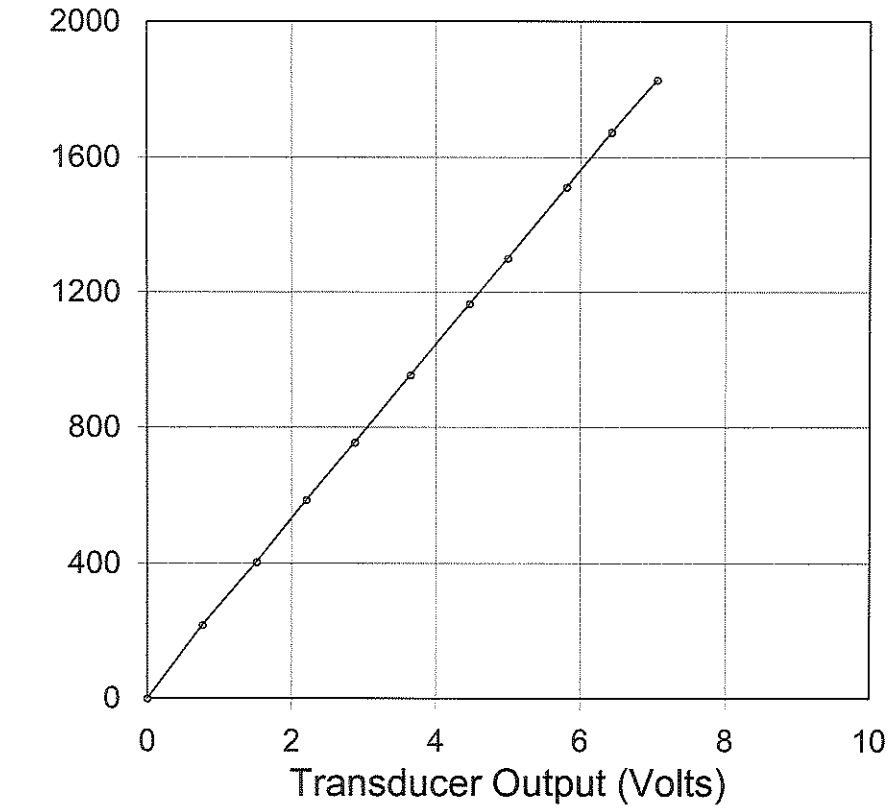

PDA Cal Factor (5.0 V) 129.2με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
218	0.76
404	1.51
585	2.20
754	2.87
954	3.64
1165	4.46
1299	5.00
1513	5.80
1675	6.42
1828	7.05

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 448.6με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by: James Bartholoff

Calibrated on: 13-Apr-2009

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2