Pile Dynamics, Inc.

Transducer 884W

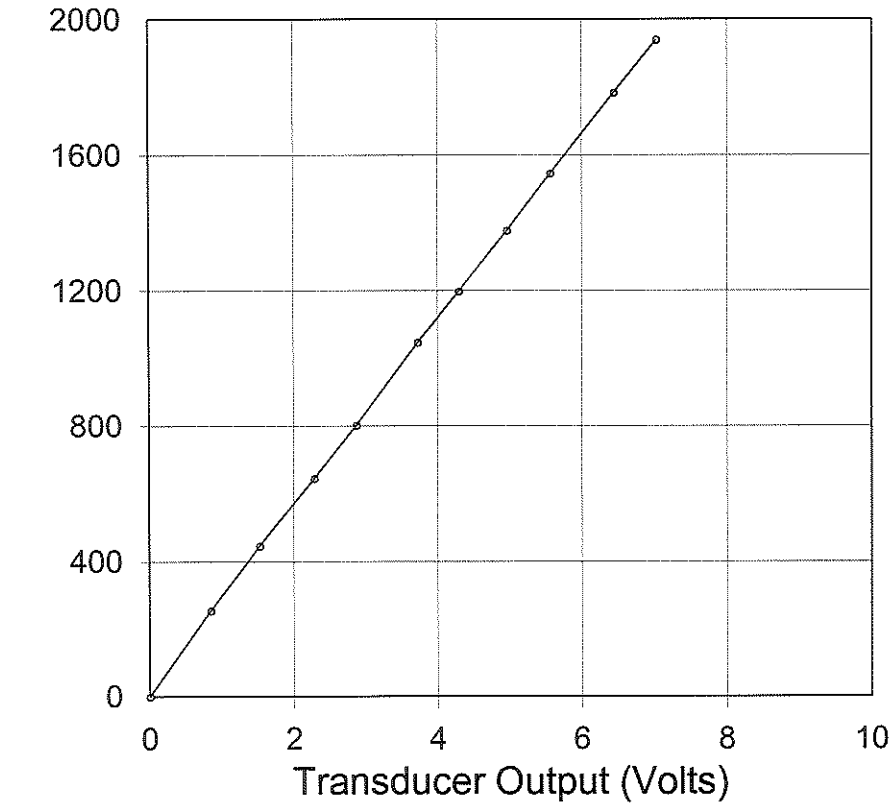

PDA Cal Factor (5.0 V) 137.2με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
255	0.84
445	1.52
645	2.28
803	2.87
1046	3.73
1197	4.29
1378	4.96
1548	5.56
1784	6.44
1940	7.03

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 476.5με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 13-Apr-2009

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2