Pile Dynamics, Inc.

Transducer 890W

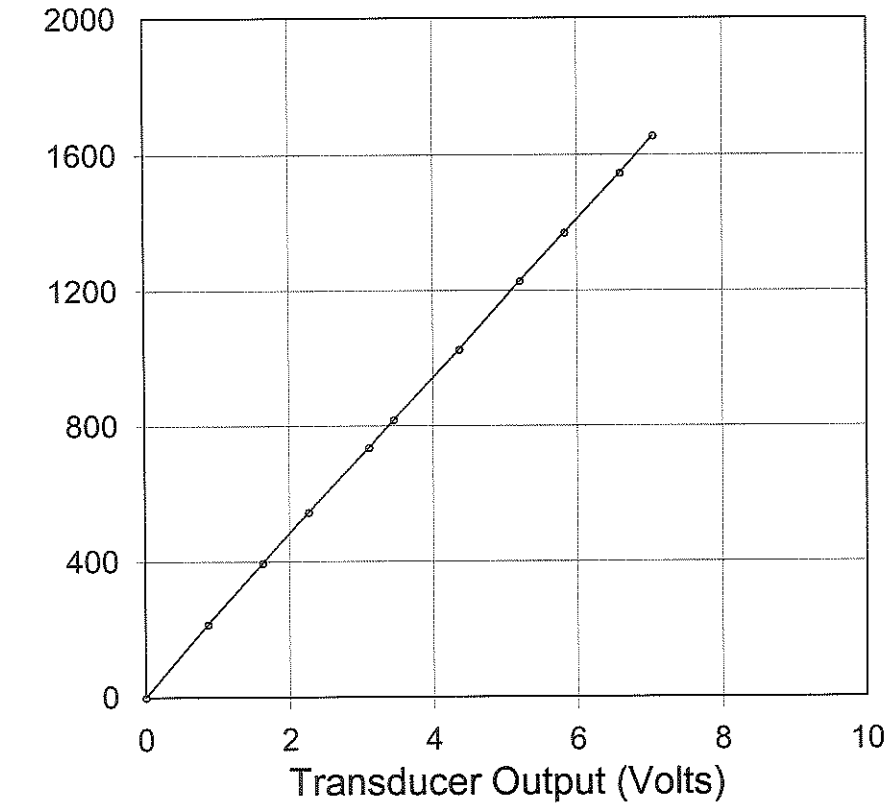

PDA Cal Factor (5.0 V) 116.7με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
216	0.86
394	1.63
545	2.26
735	3.10
817	3.45
1025	4.36
1227	5.20
1371	5.82
1548	6.60
1654	7.05

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 405.1με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by: James Deutsch

Calibrated on: 13-Apr-2009

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2