Pile Dynamics, Inc.

Transducer 891W

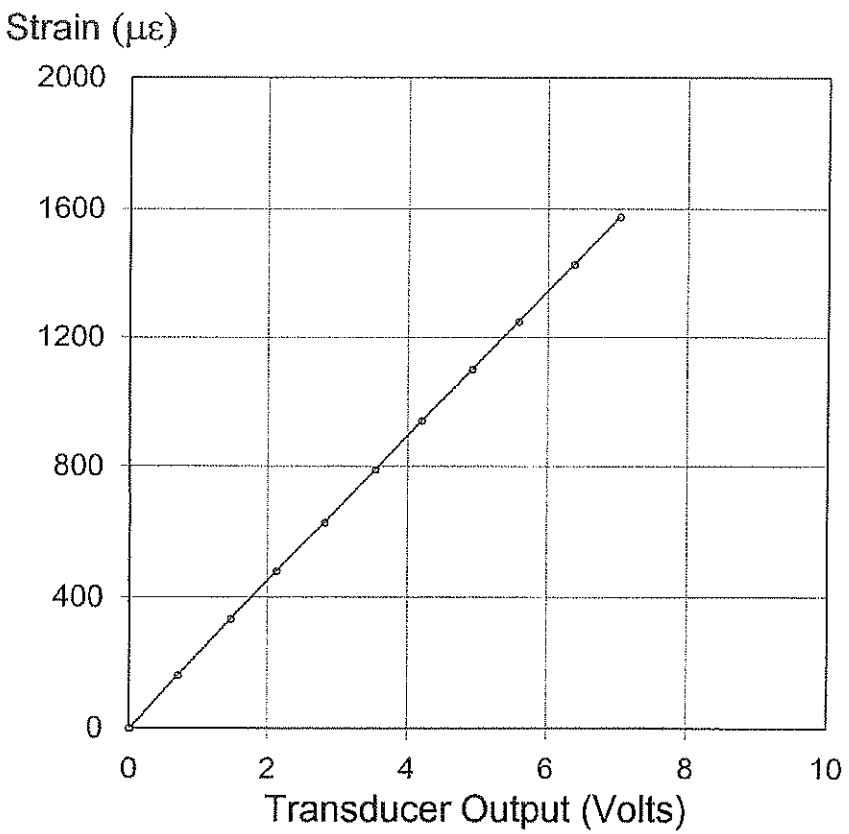

PDA Cal Factor (5.0 V) 111.8με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
164	0.70
335	1.46
479	2.12
627	2.81
789	3.53
940	4.19
1102	4.91
1250	5.57
1430	6.37
1576	7.03

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 388.2με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 15-Mar-2010

Strain Transducer Calibrator System 2009 Version 1.3