Pile Dynamics, Inc.

Transducer 893W

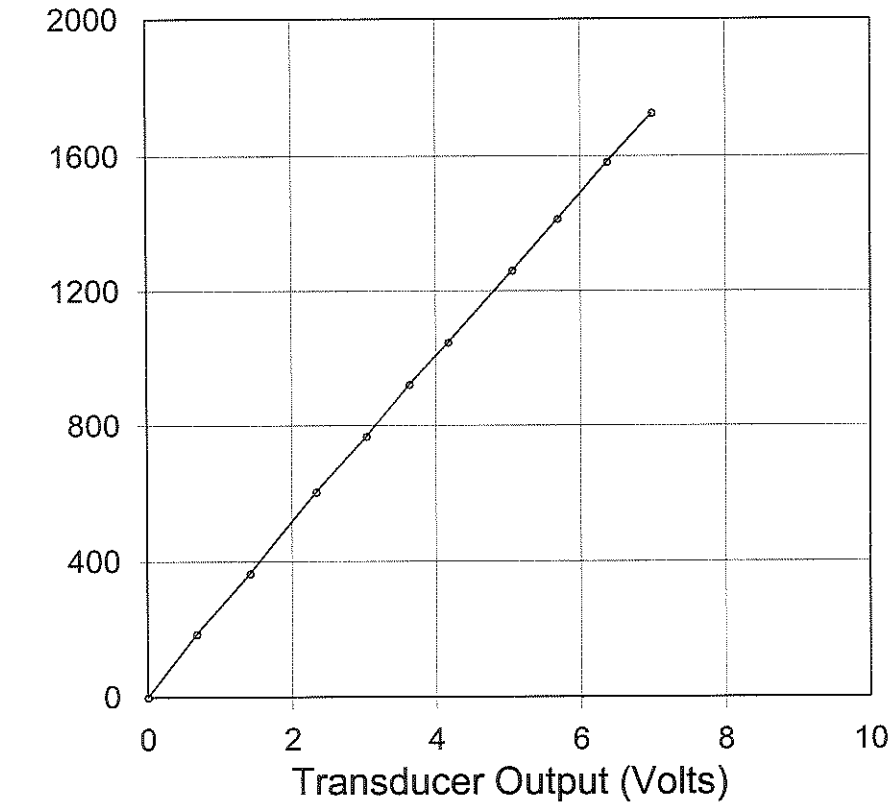

PDA Cal Factor (5.0 V) 123.1με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
186	0.67
364	1.41
603	2.33
767	3.04
921	3.63
1047	4.17
1262	5.06
1413	5.68
1584	6.37
1727	6.99

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 427.3με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by: _____

Calibrated on: 16-Apr-2009

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2