Pile Dynamics, Inc.

Transducer 894W

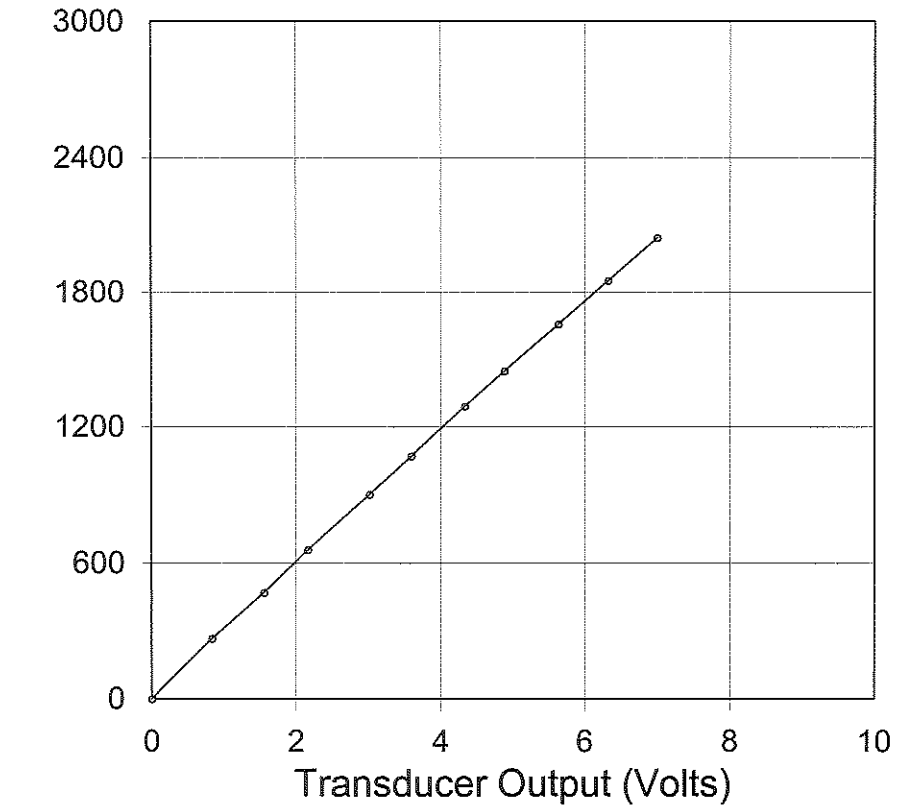

PDA Cal Factor (5.0 V) 145.5με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
267	0.84
470	1.55
656	2.16
902	3.01
1070	3.59
1289	4.33
1446	4.88
1657	5.63
1853	6.32
2044	7.00

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 505.3με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 16-Apr-2009

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2